


監控點圖表

監控點: 902-臨床試驗中心-(下) 電話: 3933

時間區間: 2025-05-01 00:00 ~ 2025-05-31 23:59

最大值: -20.7 °C      最小值: -23.3 °C      平均值: -22.0 °C

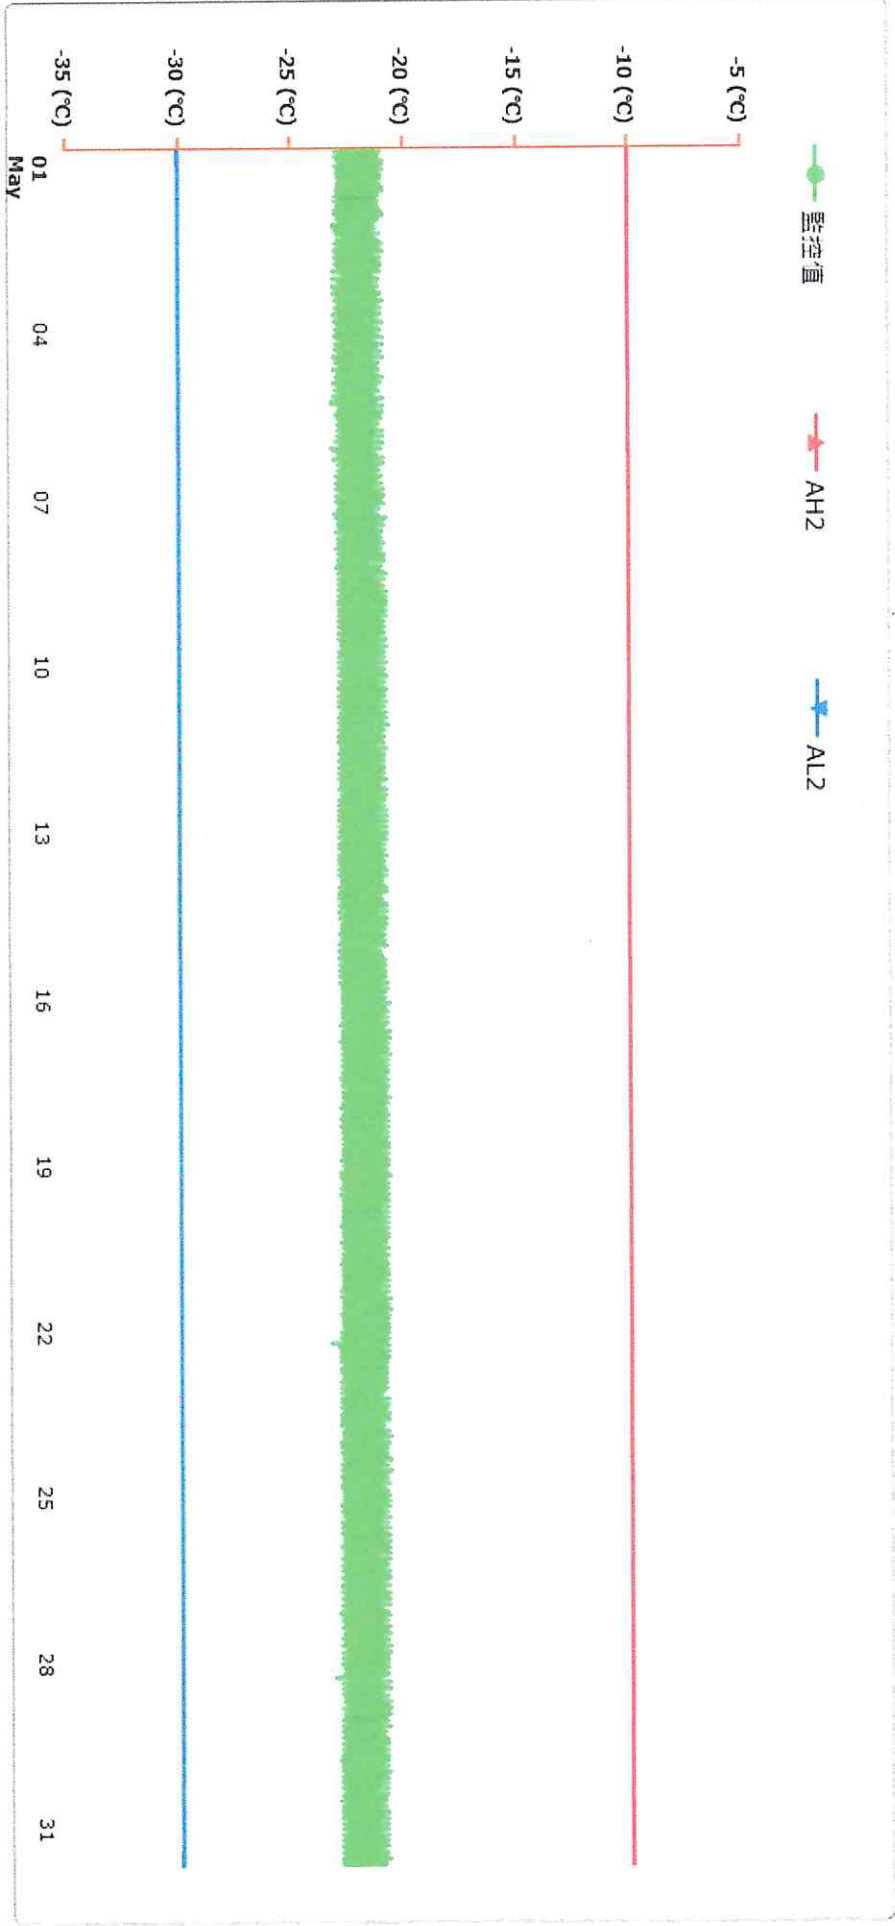

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

賴亞萍 2025 January