

監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -29.4 °C

最小值: -35.9 °C

平均值: -34.5 °C

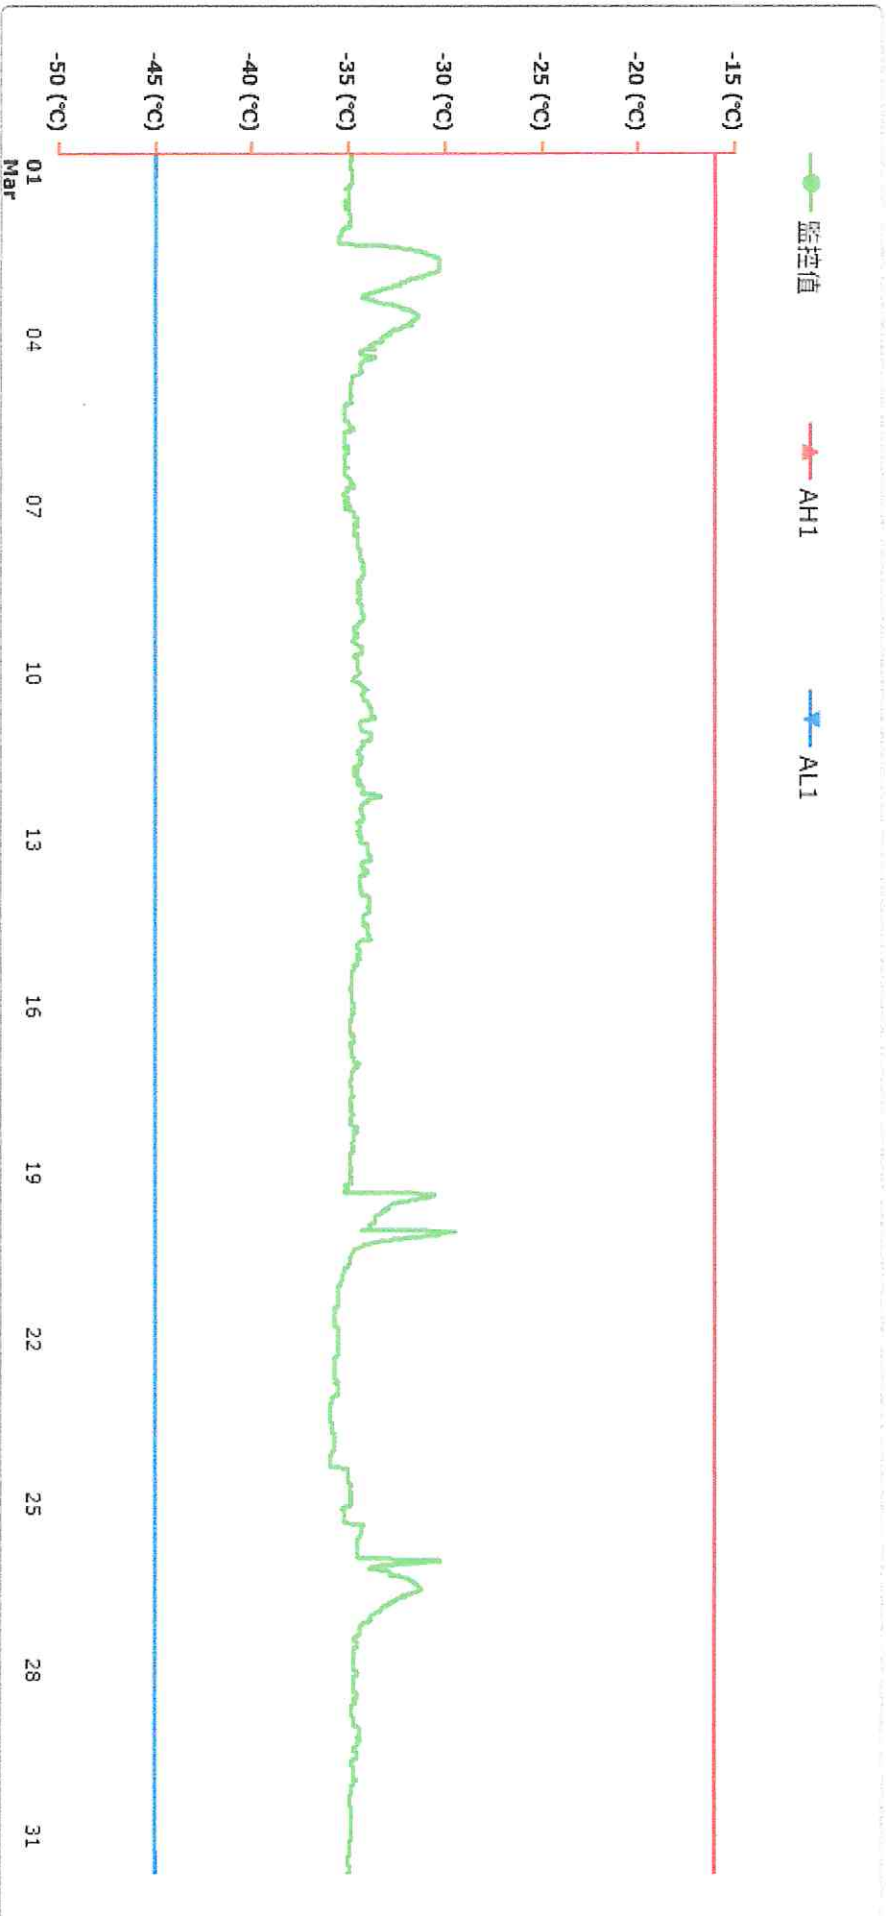

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬良 2026.04.02

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -24 °C

最小值: -31 °C

平均值: -29.1 °C

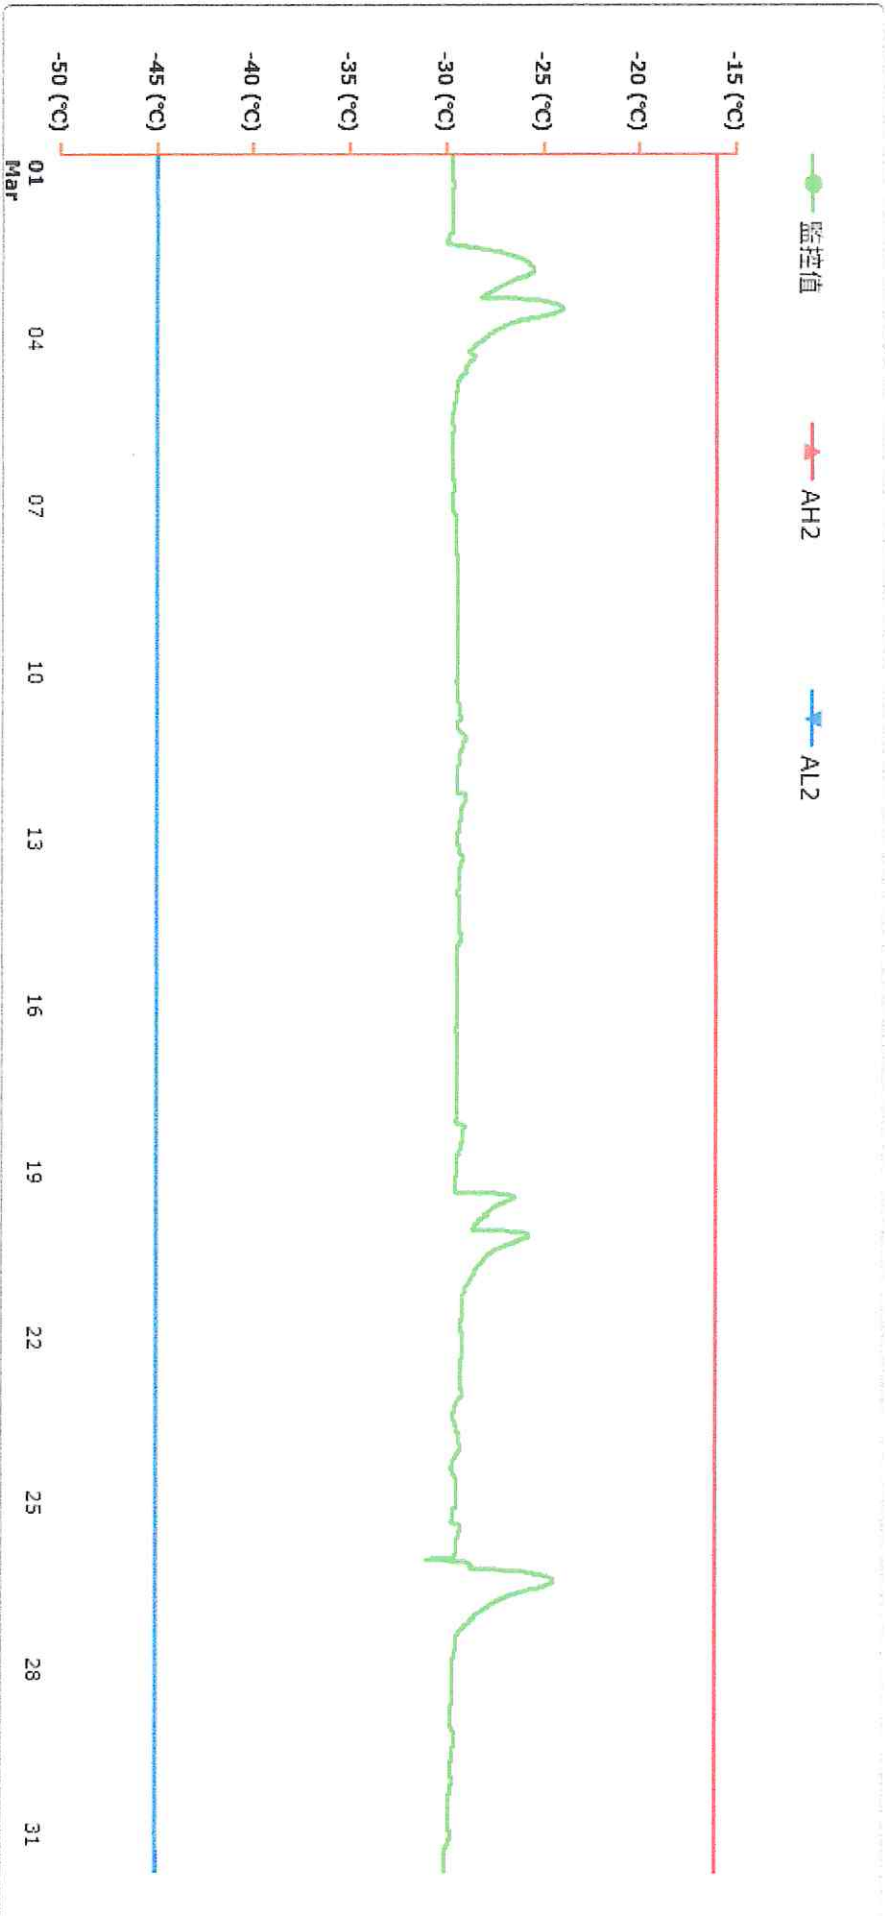

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬 2026.04.02