

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2026-04-01 00:00 ~ 2026-04-30
23:59

最大值: -28.5 °C

最小值: -35.5 °C

平均值: -33.8 °C

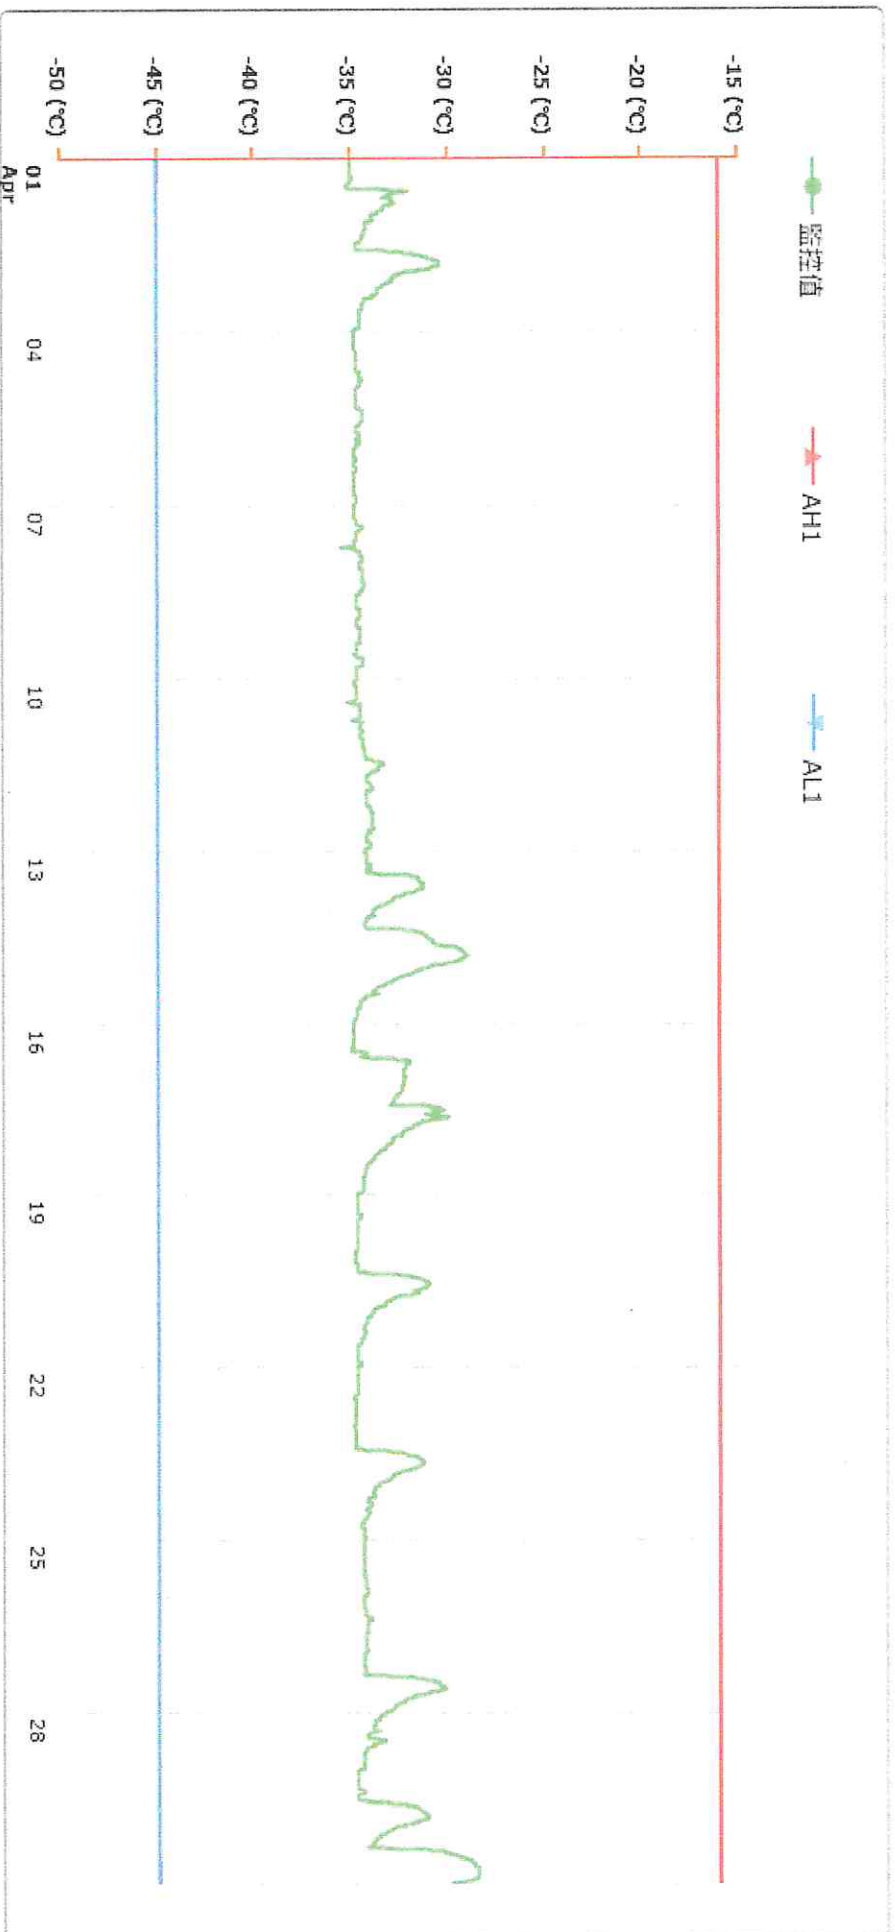

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑曼 2026.05.28

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2026-04-01 00:00 ~ 2026-04-30
23:59

最大值: -21.2 °C

最小值: -30.1 °C

平均值: -28.5 °C

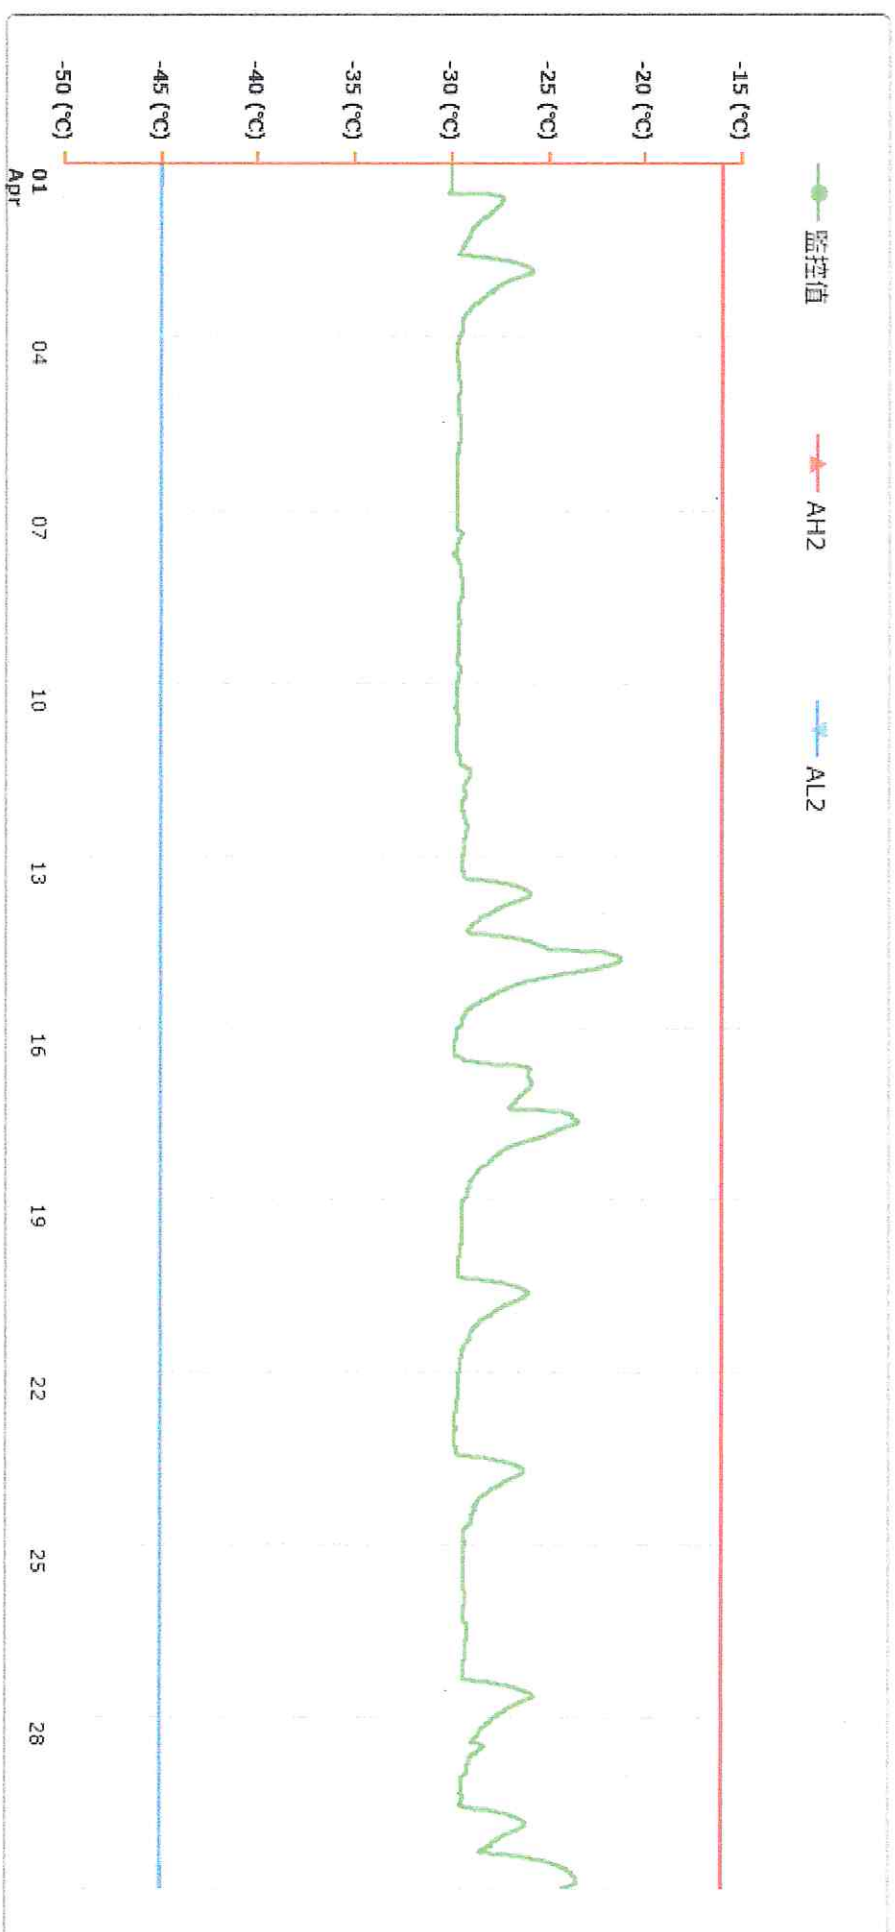

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.05.08