

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2026-05-01 00:00 ~ 2026-05-31 23:59

最大值: -26.5 °C

最小值: -35.9 °C

平均值: -33.5 °C

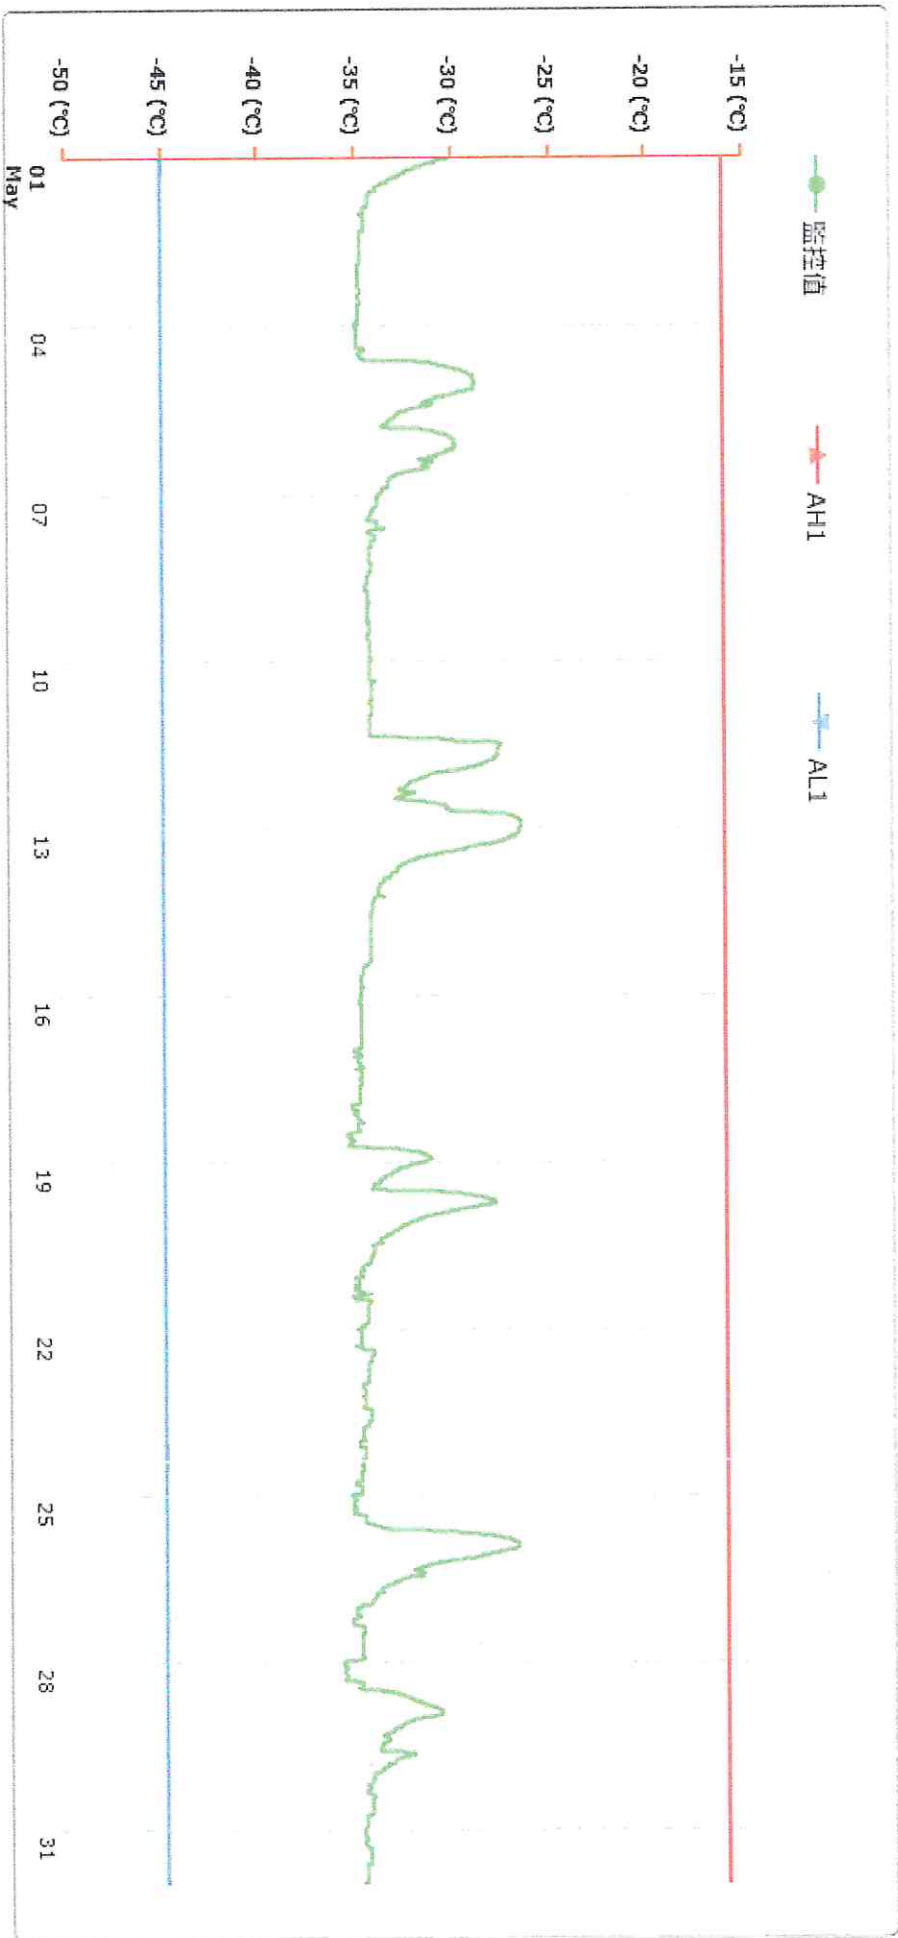

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2026.06.09

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話:3933

時間區間: 2026-05-01 00:00 ~ 2026-05-31 23:59

最大值: -19 °C

最小值: -30 °C

平均值: -28.0 °C

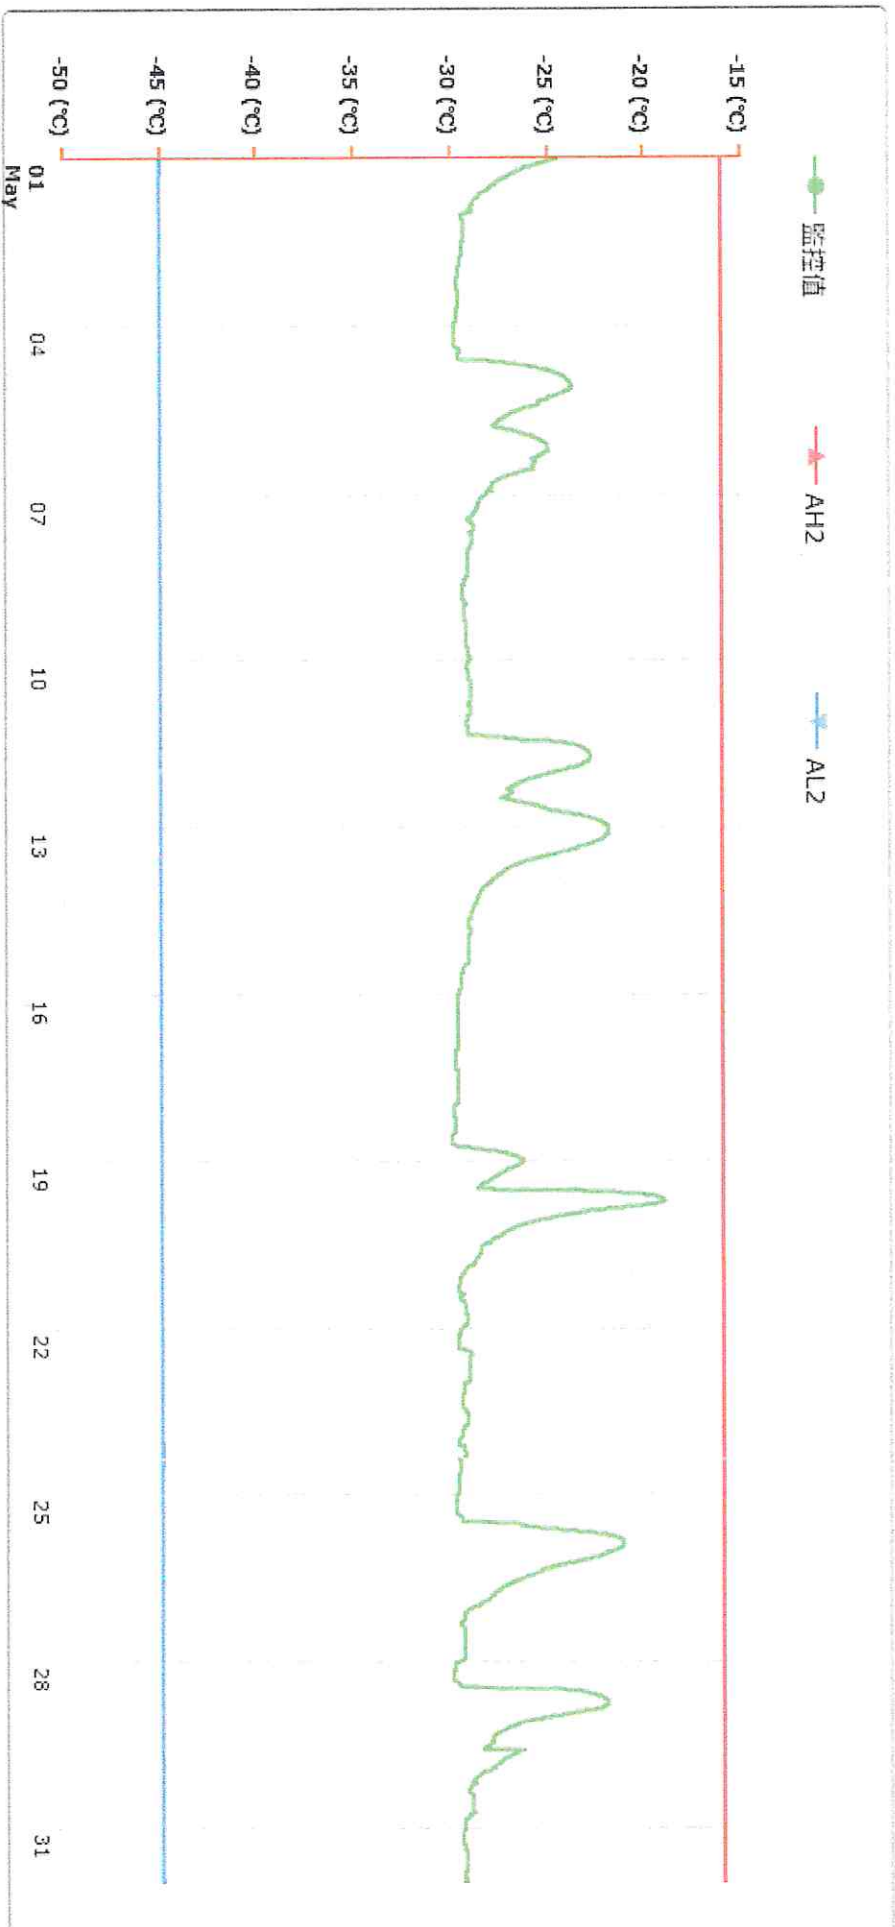

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2026.06.09