

監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電


話: 3933

時間區間: 2024-01-01 00:00 ~ 2024-01-31 23:59

最大值: -23.6 °C

最小值: -39.3 °C

平均值: -37.3 °C

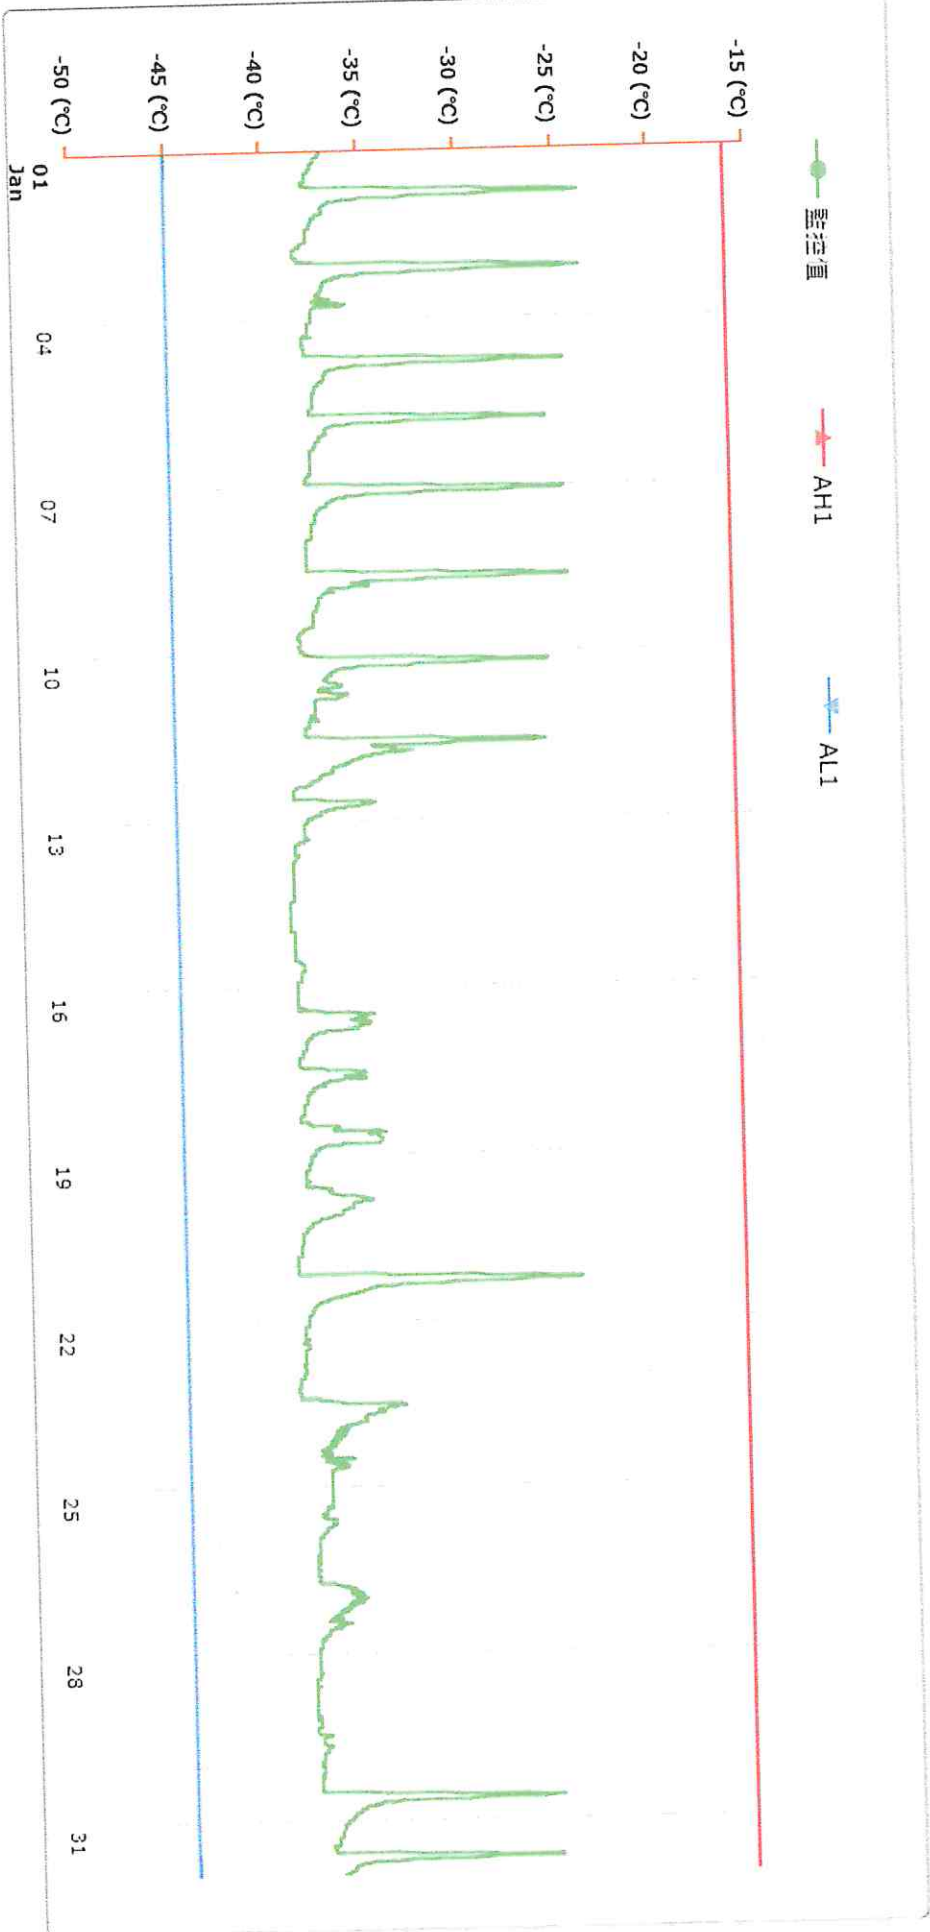

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英

2024.02.06

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電


時間區間: 2024-01-01 00:00 ~ 2024-01-31 23:59

話: 3933

最大值: -26.4 °C

最小值: -33.8 °C

平均值: -31.9 °C

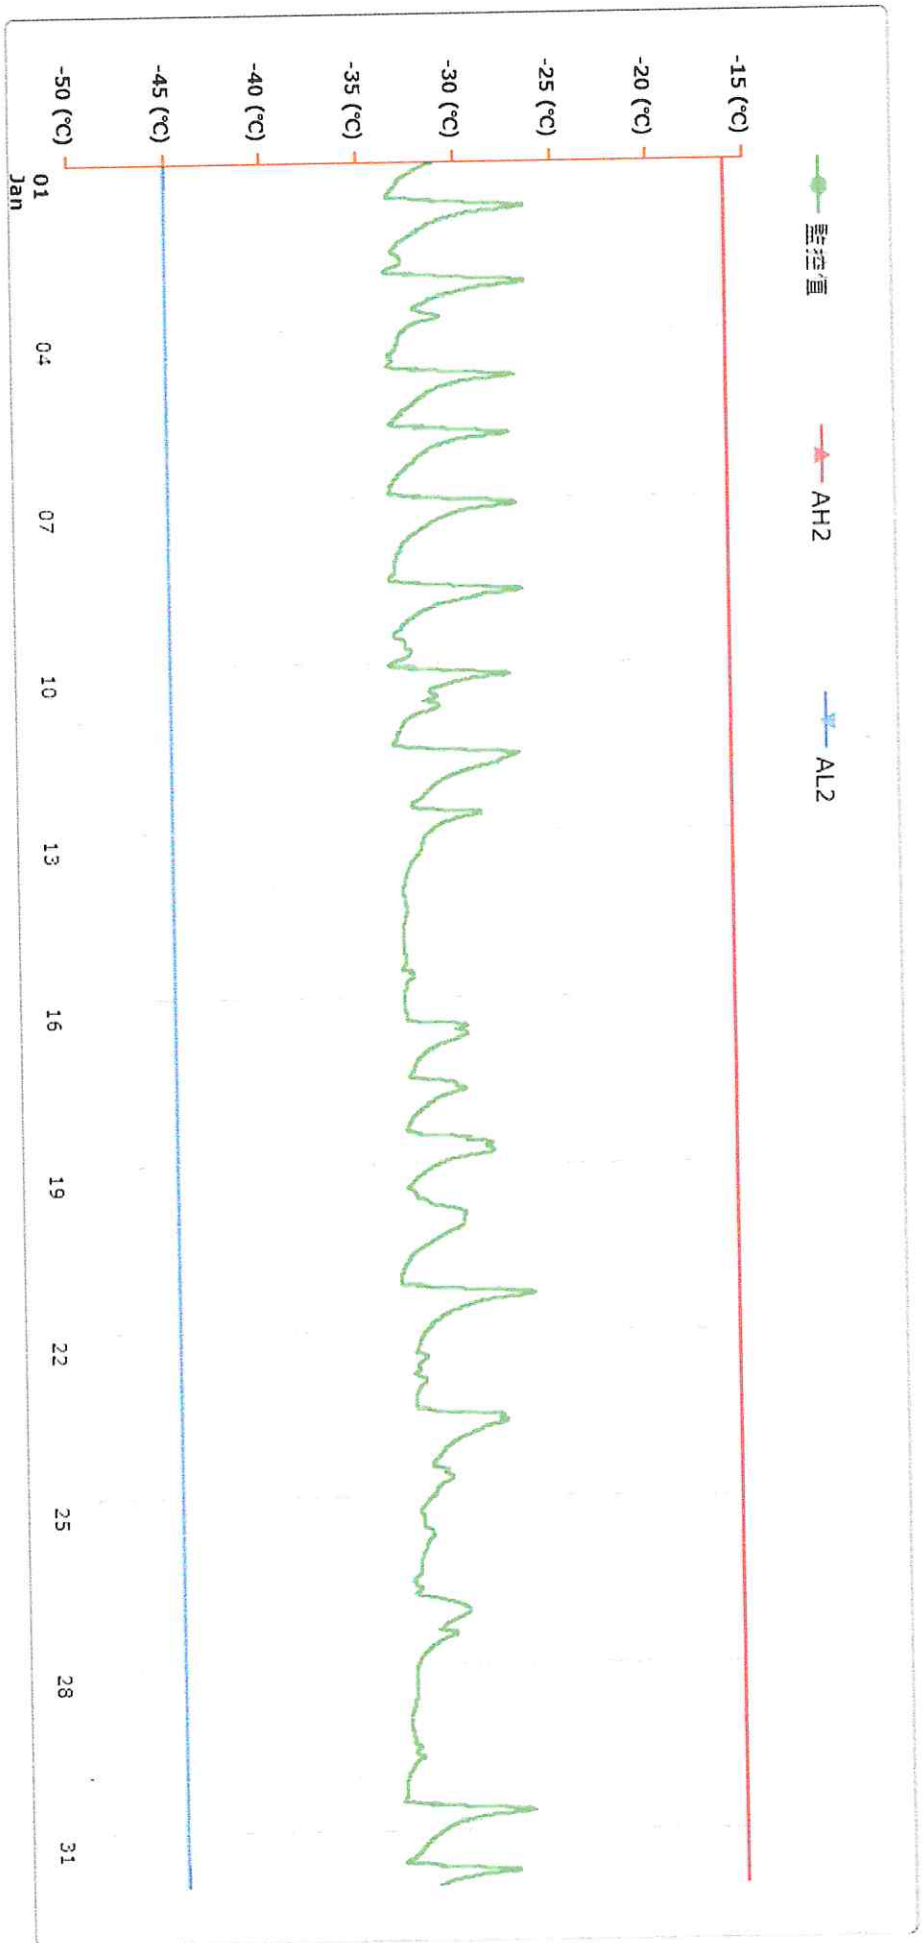

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.02.06