

監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電


話: 3933

時間區間: 2024-02-01 00:00 ~ 2024-02-29 23:59

最大值: -23.8 °C

最小值: -39.5 °C

平均值: -37.2 °C

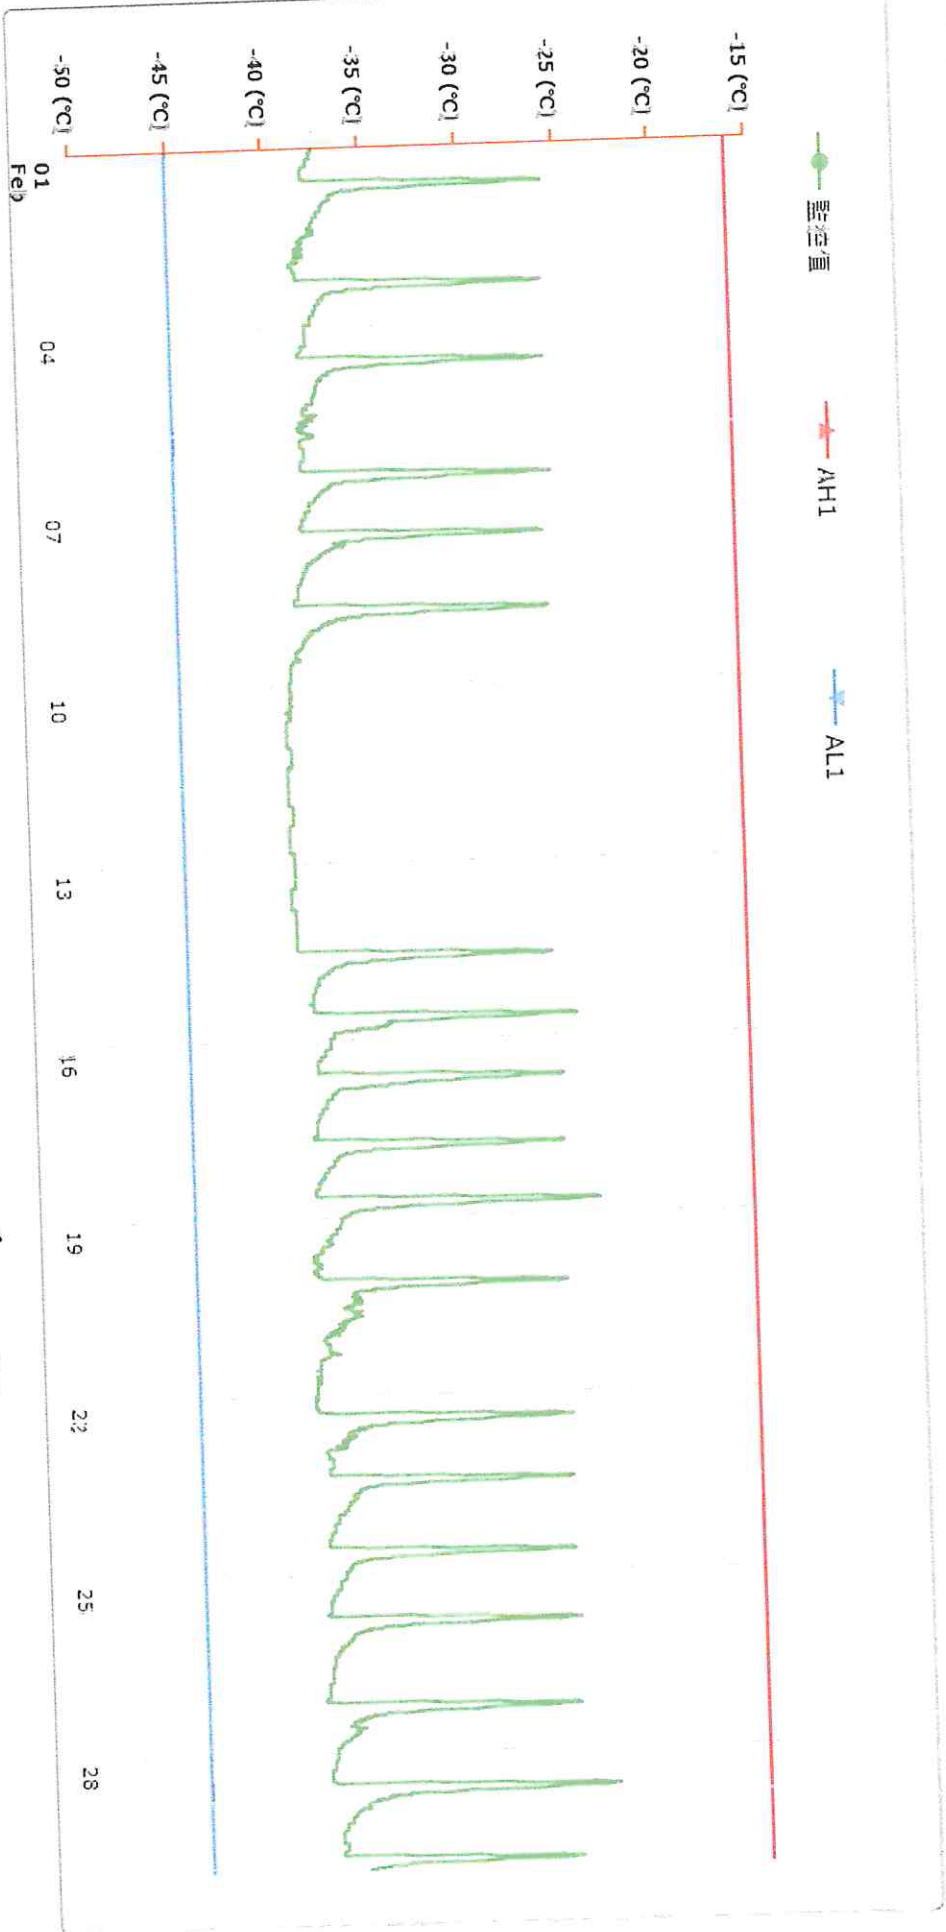

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬安 2024.03.07

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電


時間區間: 2024-02-01 00:00 ~ 2024-02-29 23:59

話: 3933

最大值: -26.2 °C

最小值: -34.1 °C

平均值: -32.1 °C

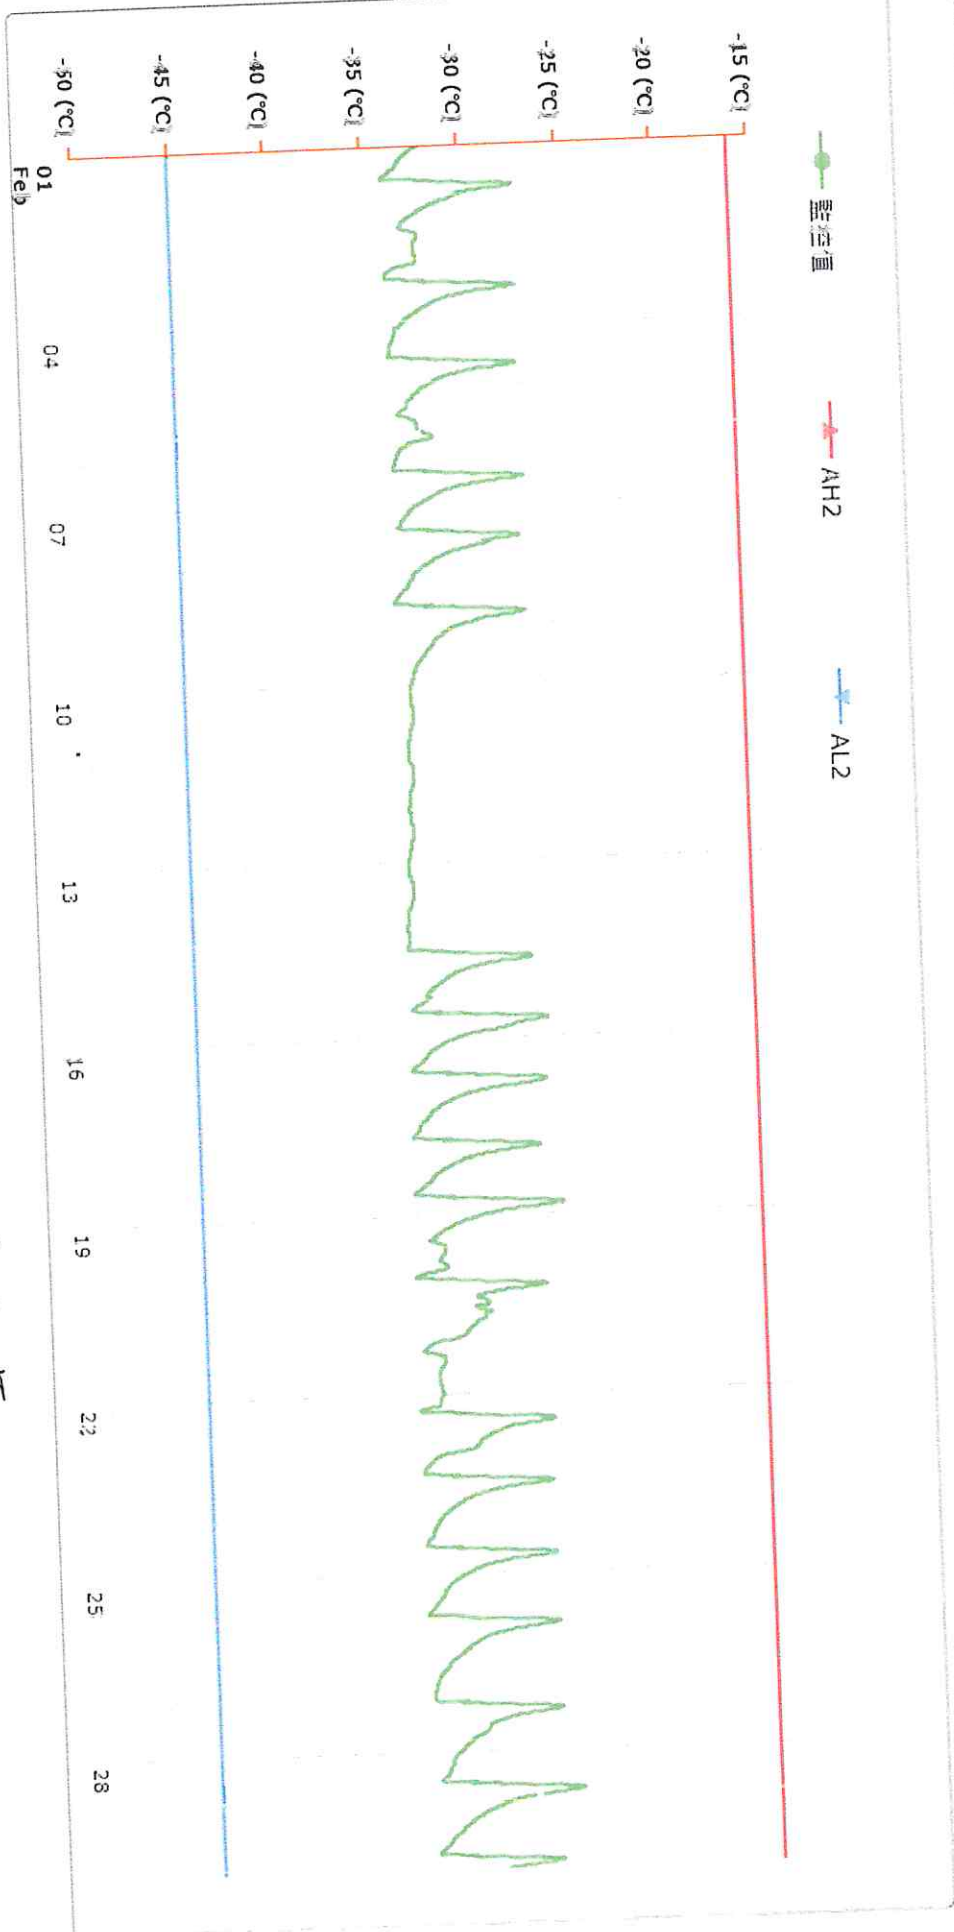

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.03.07