


監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電  
話: 3933

時間區間: 2024-06-01 00:00 ~ 2024-06-30  
23:59

最大值: -24.5 °C      最小值: -38.9 °C      平均值: -36.5 °C

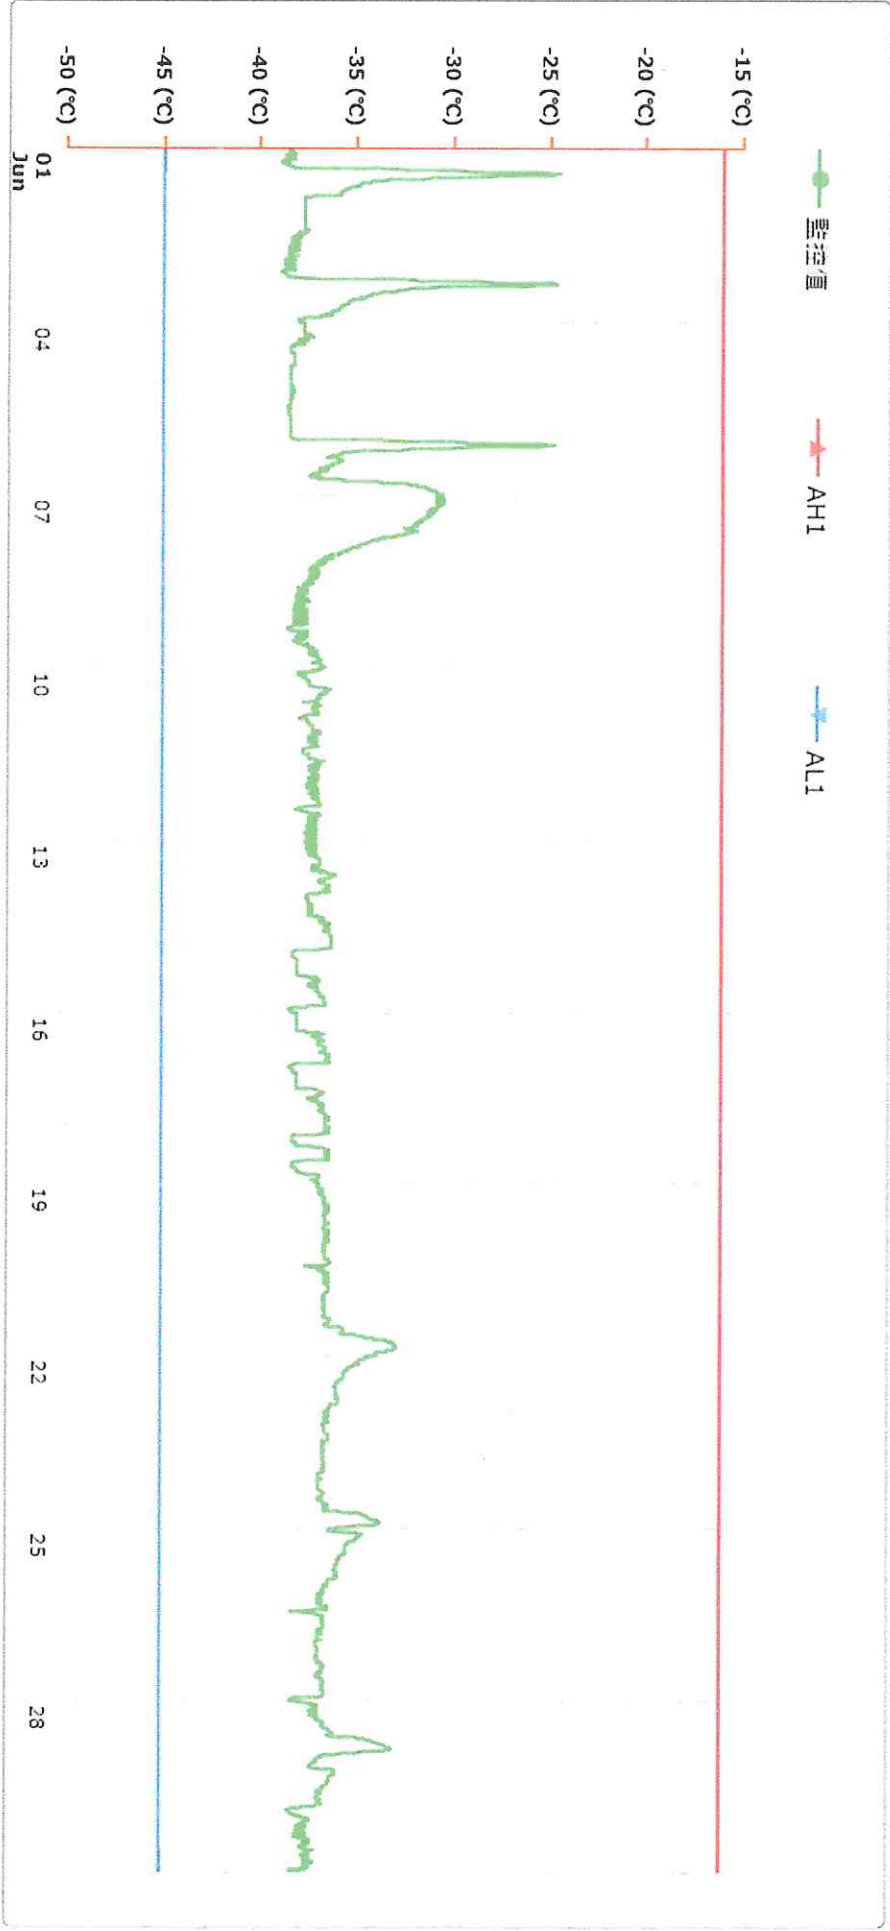

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.07.09

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電  
話: 3933

時間區間: 2024-06-01 00:00 ~ 2024-06-30 23:59

最大值: -24.2 °C

最小值: -33.5 °C

平均值: -30.9 °C

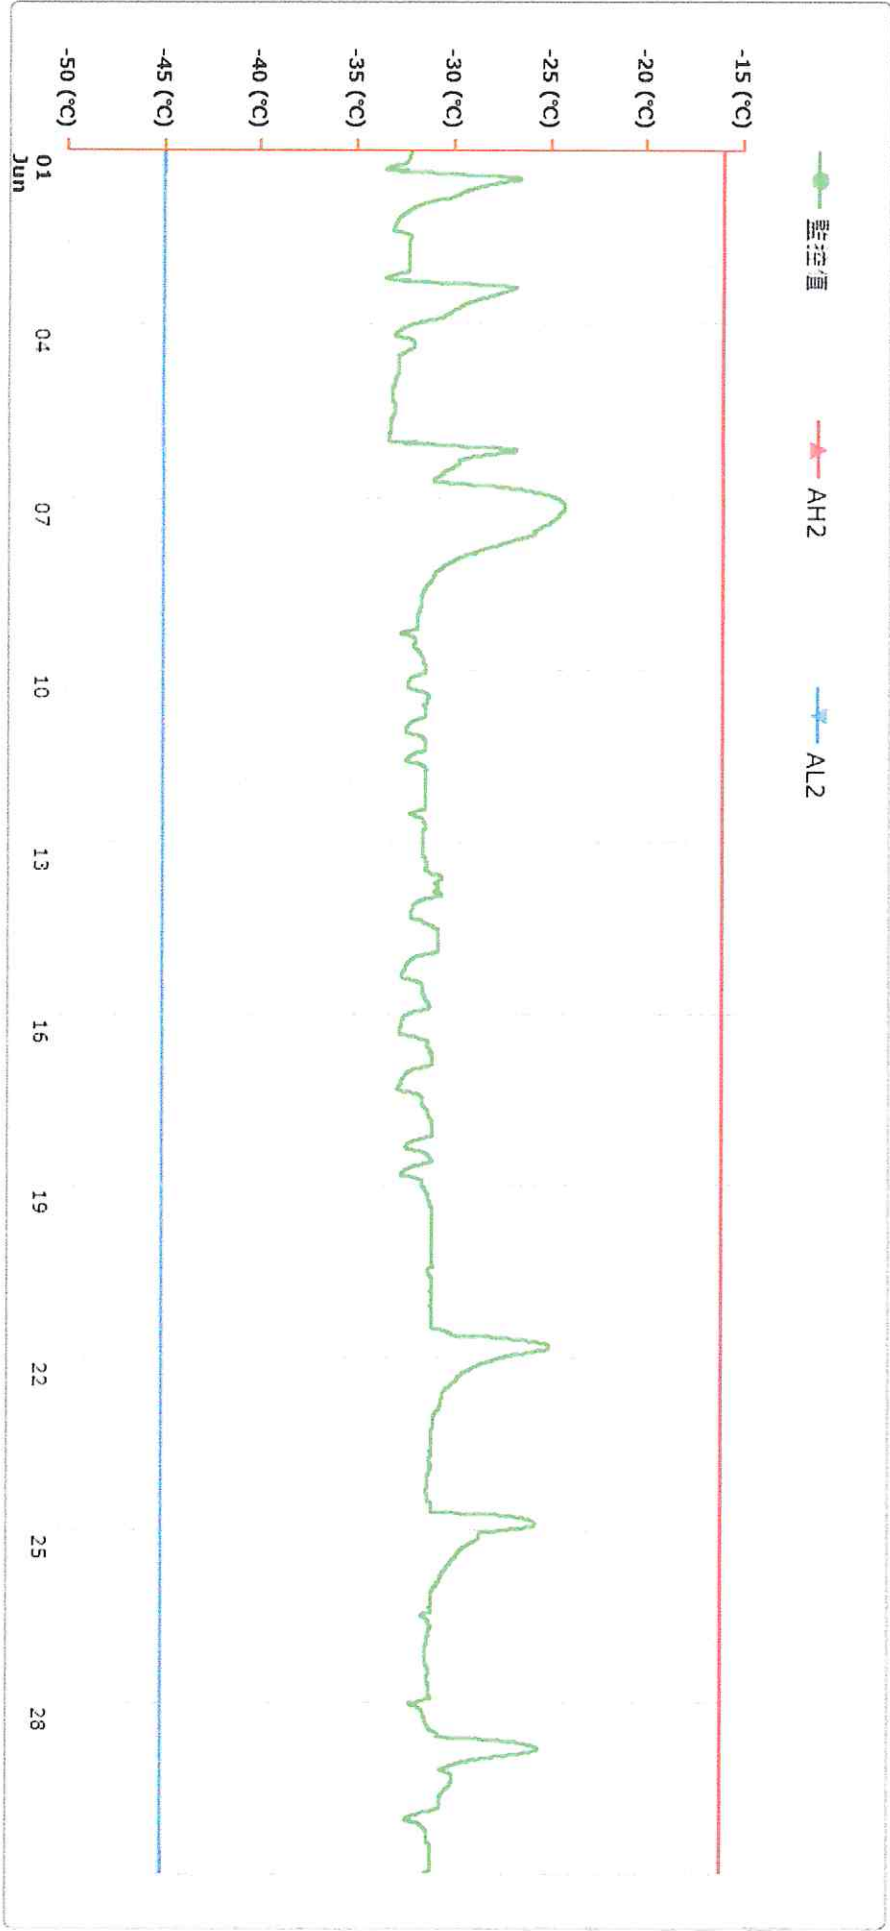

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬 2024.07.09