

監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2024-07-01 00:00 ~ 2024-07-31


話: 3933

23:59

最大值: -25.2 °C

最小值: -38.7 °C


平均值: -37.3 °C

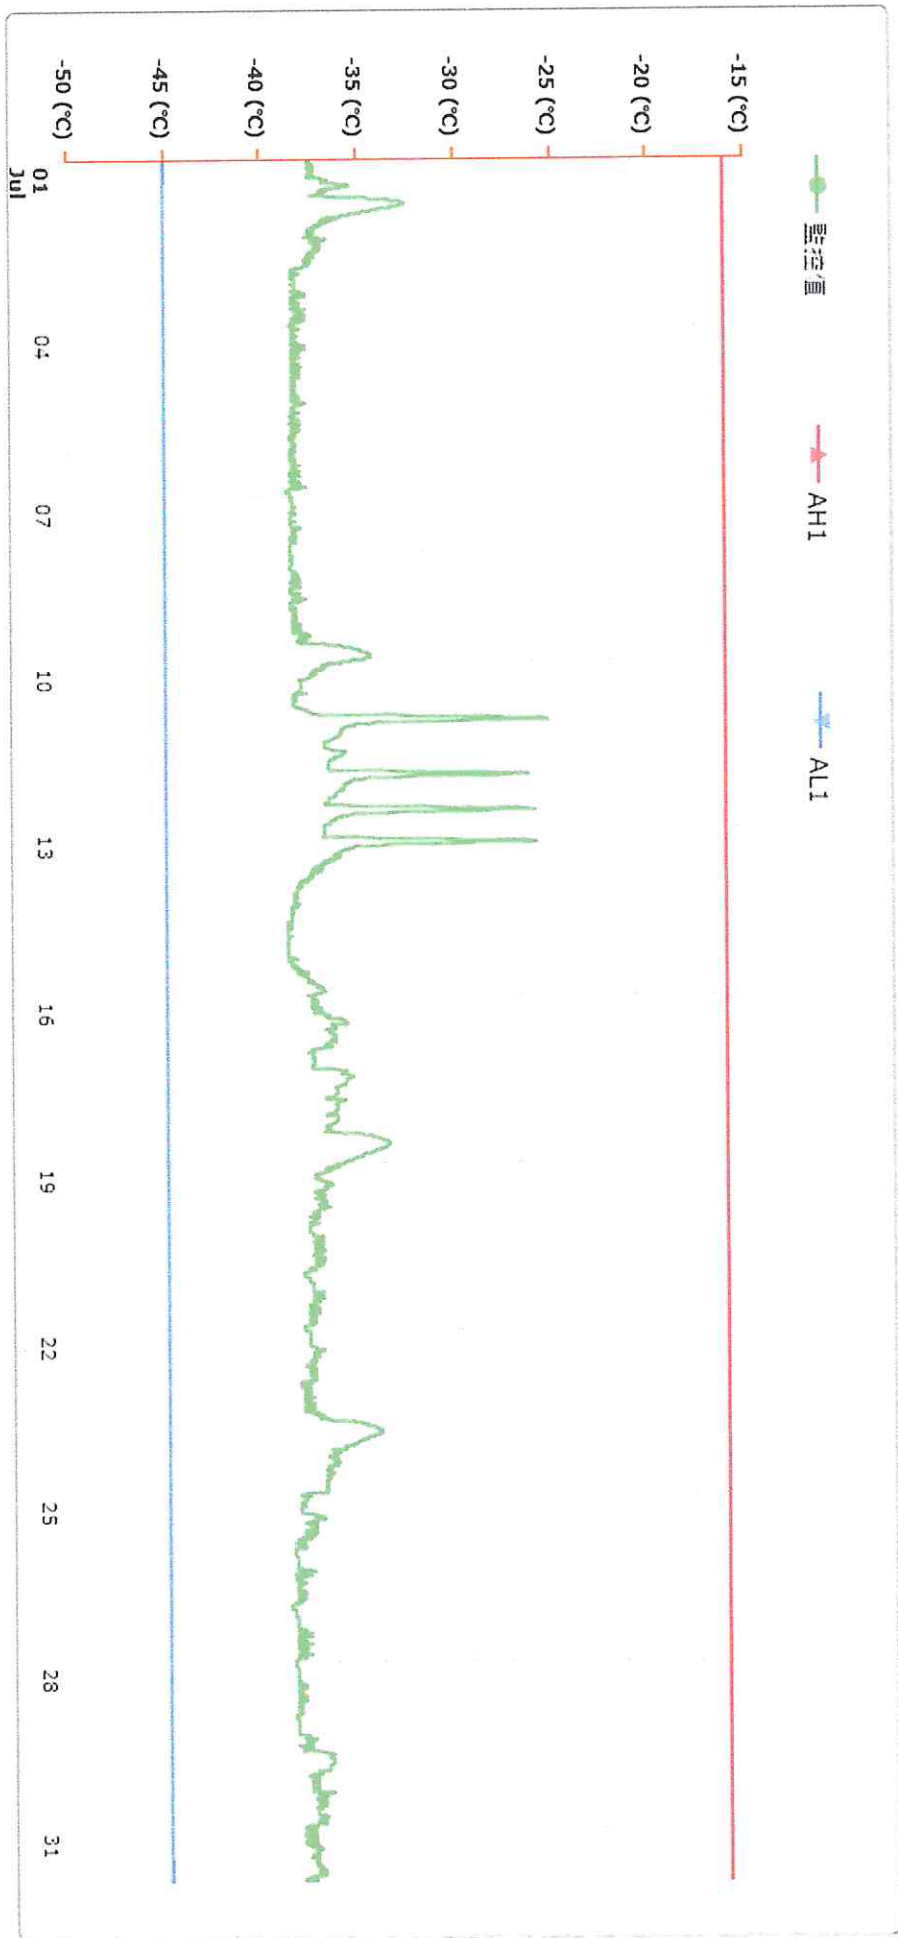

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
時間區間: 2024-07-01 00:00 ~ 2024-07-31 23:59
話: 3933

最大值: -25.7 °C 最小值: -33.8 °C 平均值: -31.4 °C

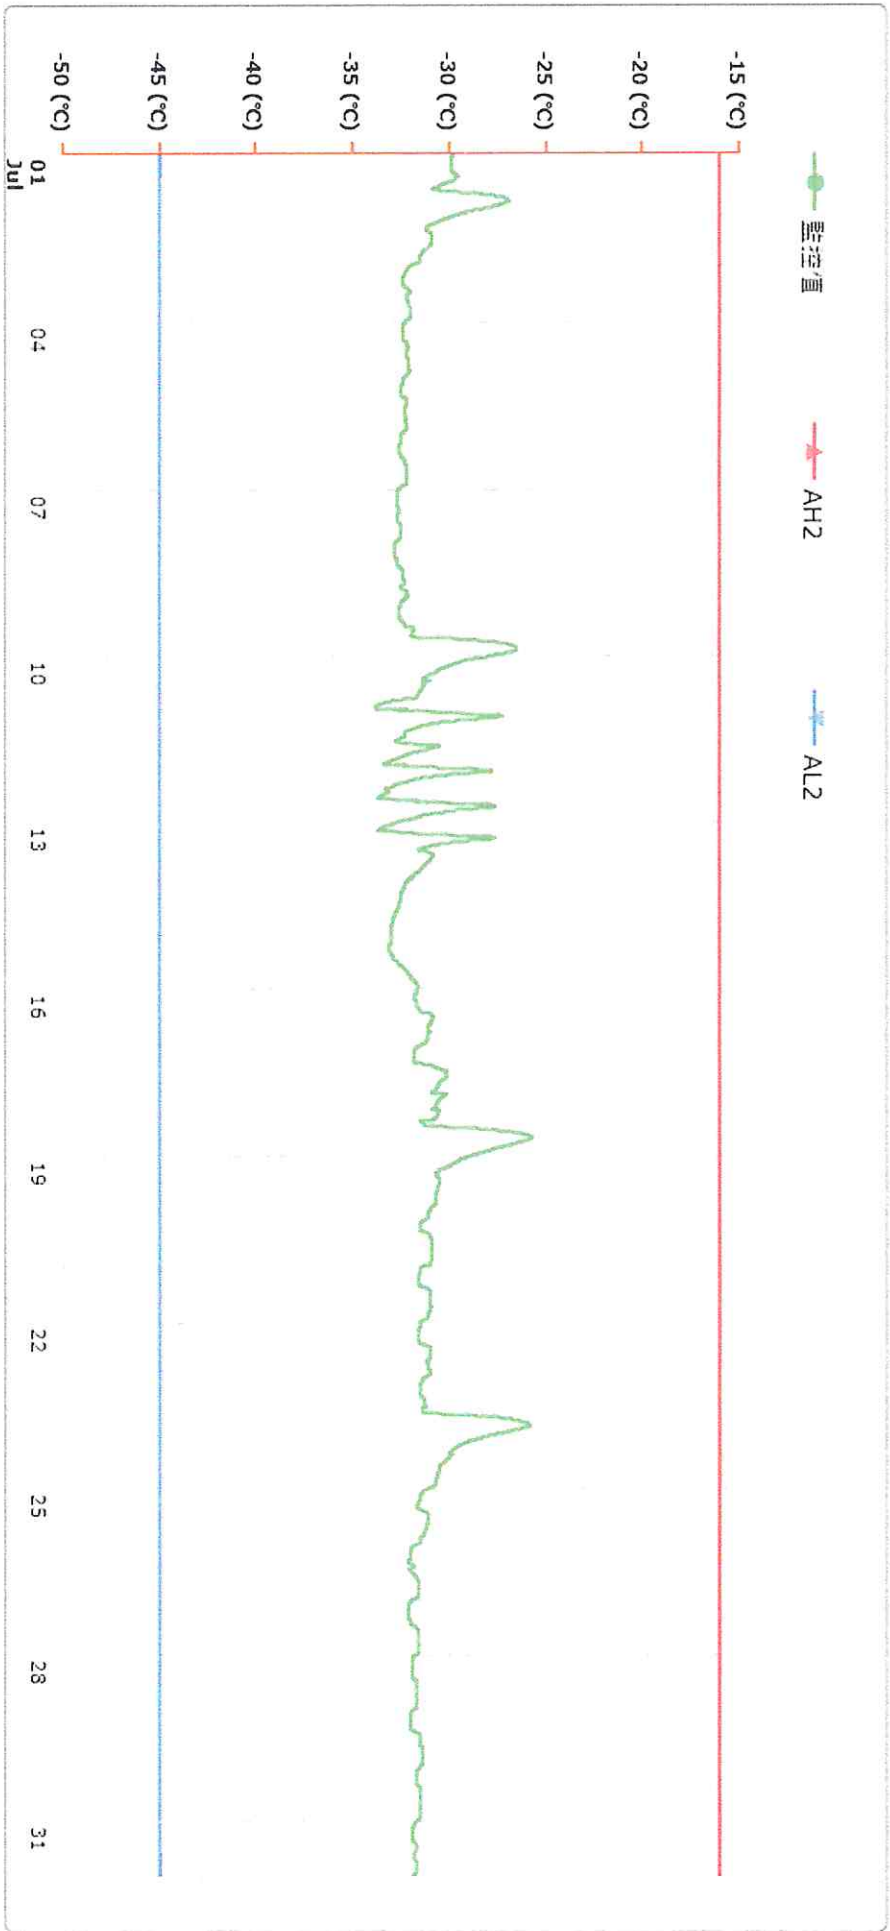

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

賴永祥 2024.08.09