


監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933
時間區間: 2024-10-01 00:00 ~ 2024-10-31 23:59

最大值: -32 °C 最小值: -38.9 °C 平均值: -37.4 °C

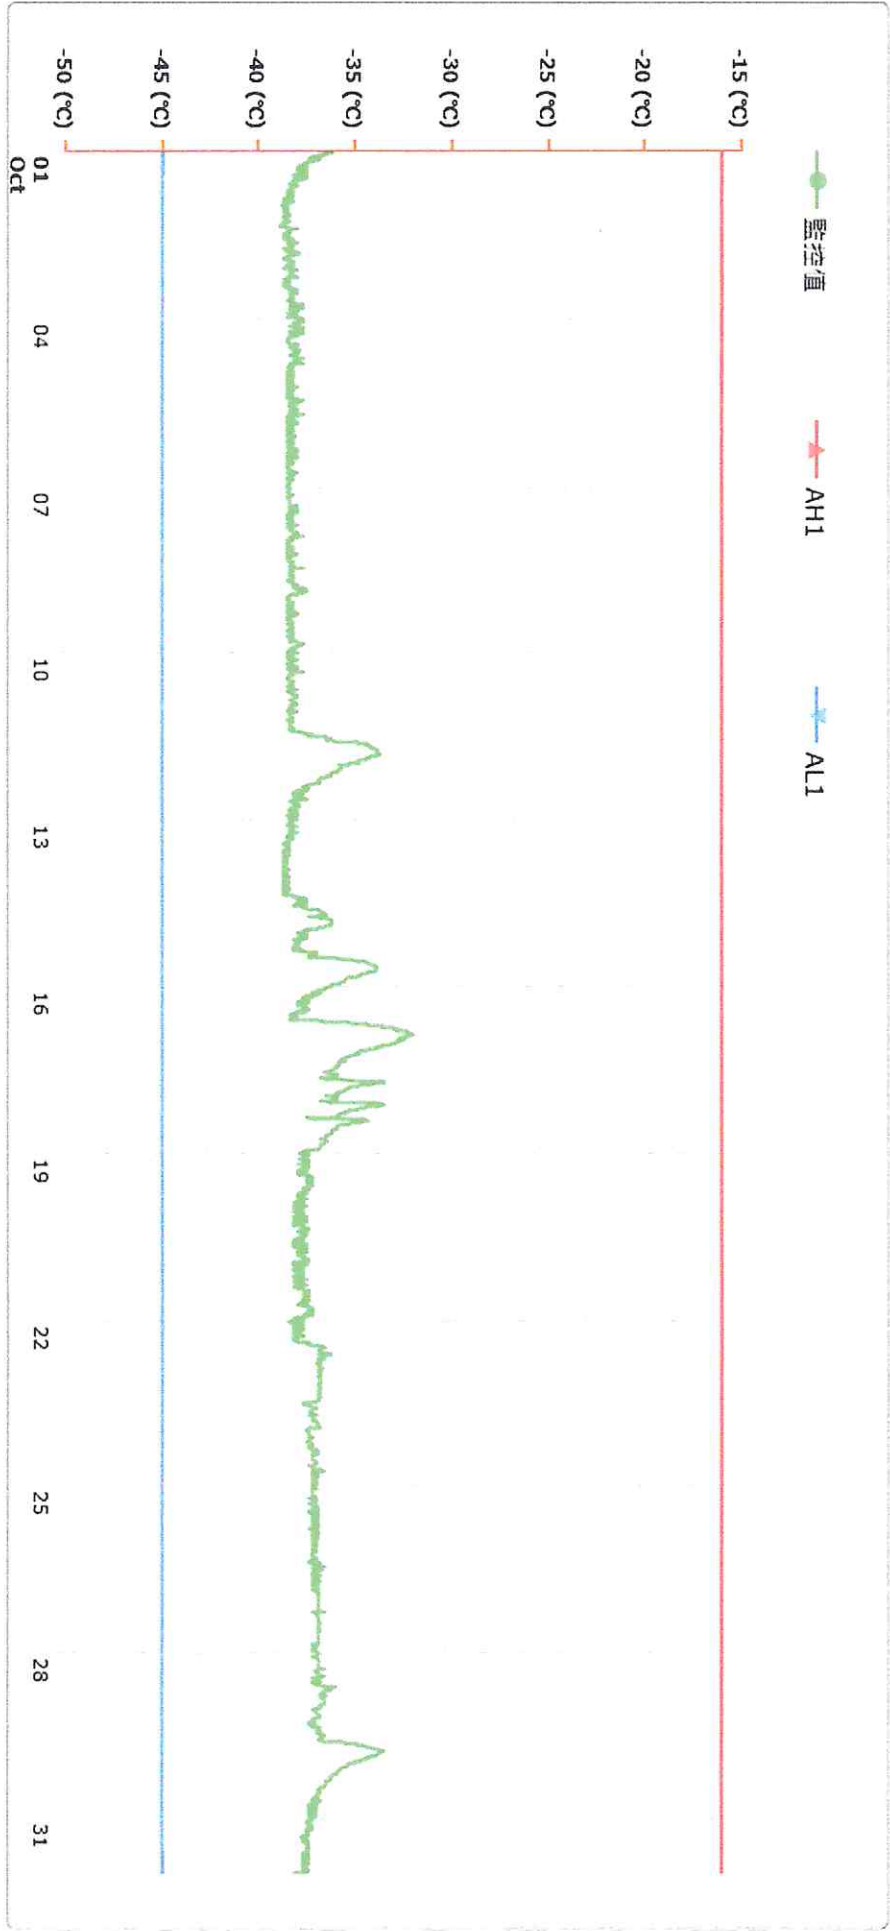

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:


許淑英 2024.11.04

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話:3933

時間區間: 2024-10-01 00:00 ~ 2024-10-31 23:59

最大值: -25.4 °C 最小值: -32.6 °C 平均值: -31.5 °C

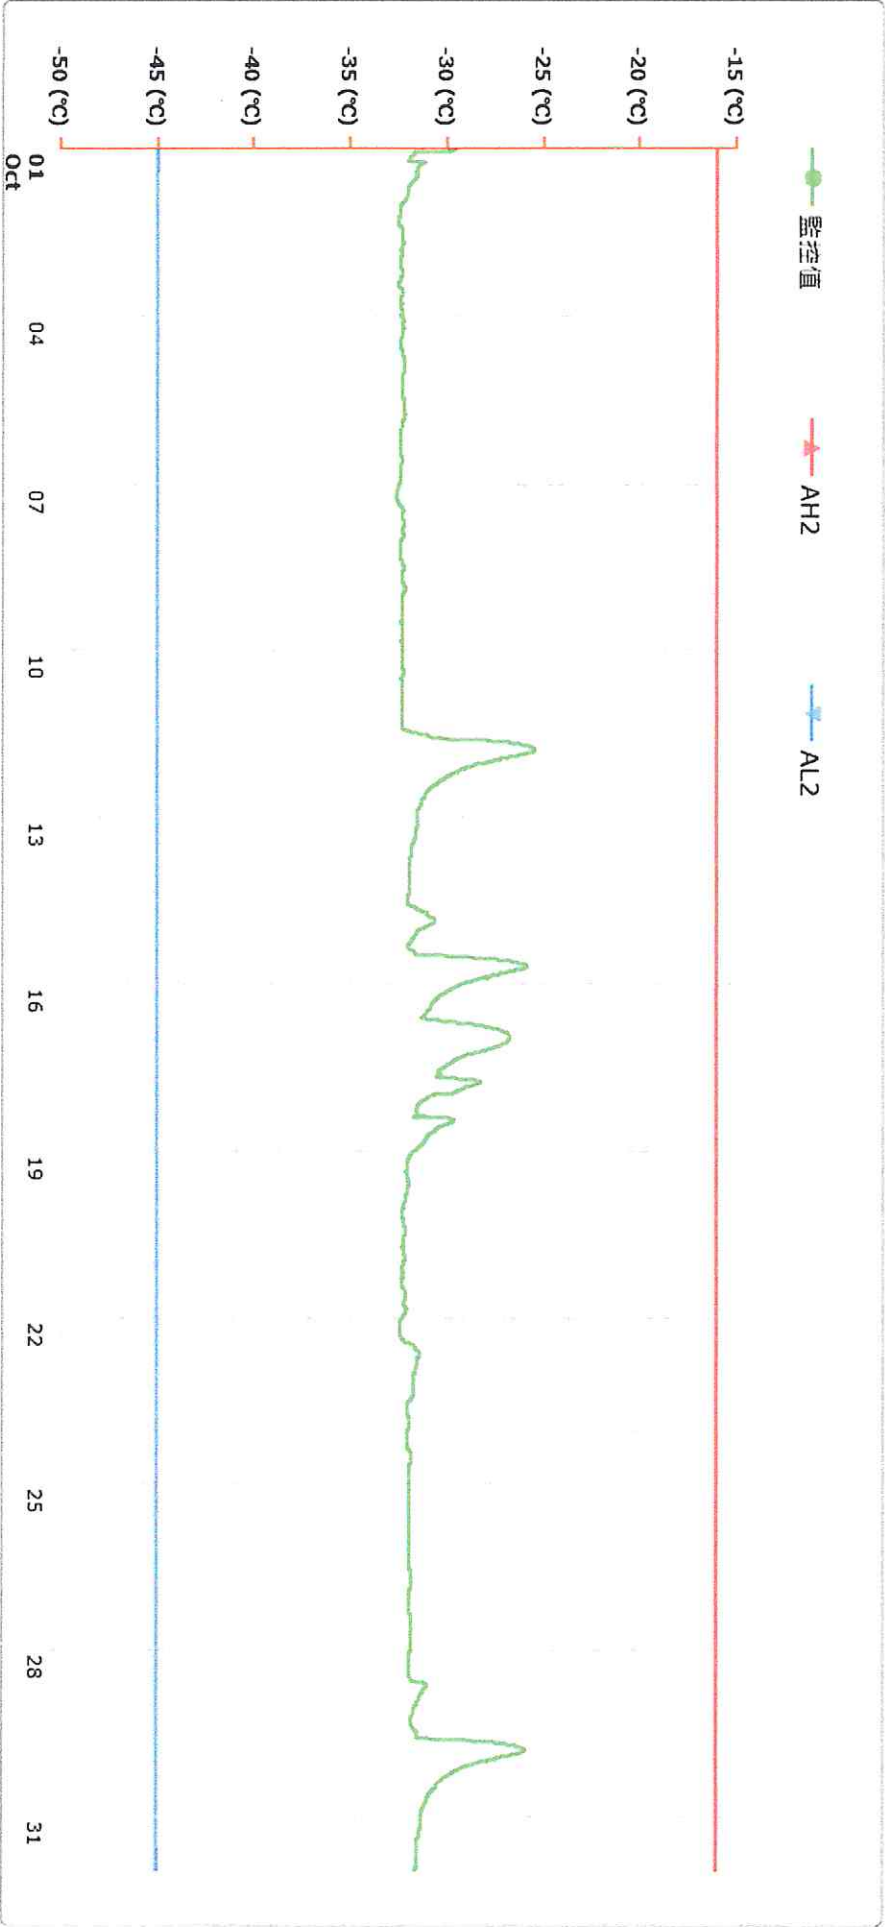

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.11.02