


監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2024-11-01 00:00 ~ 2024-11-30 23:59

最大值: -30.7 °C 最小值: -38 °C 平均值: -36.2 °C

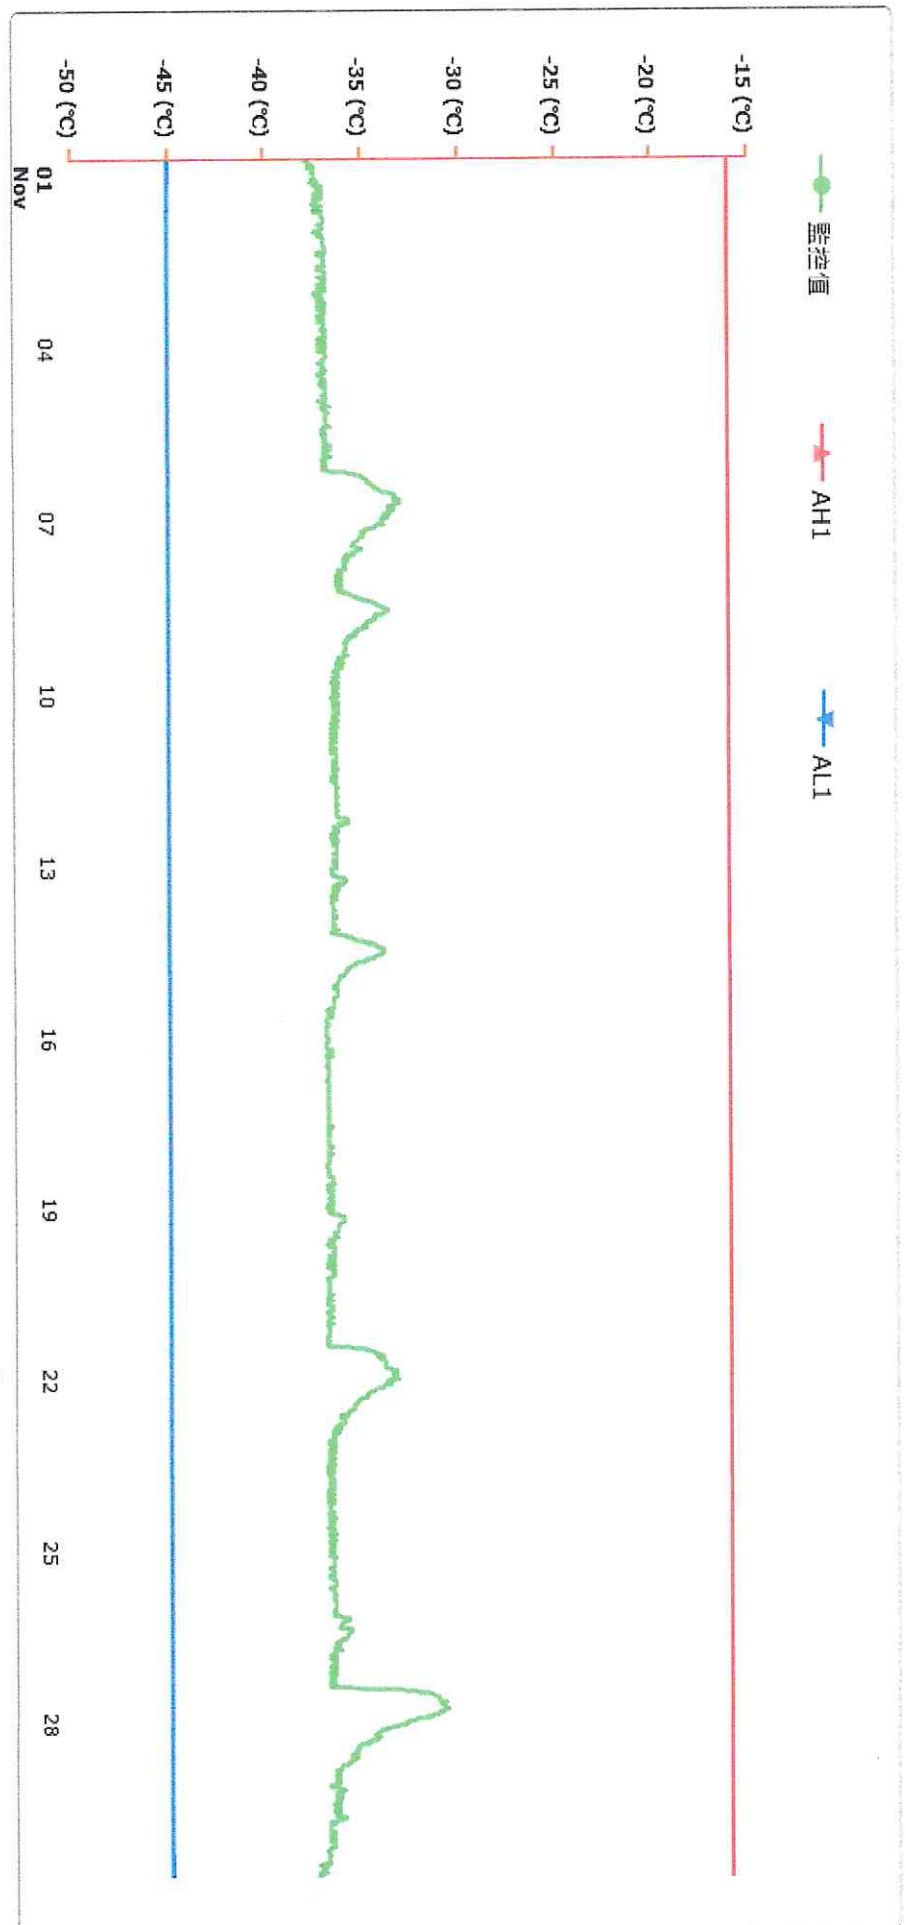

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬忠 2024.12.04

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2024-11-01 00:00 ~ 2024-11-30 23:59

最大值: -26 °C

最小值: -31.8 °C

平均值: -30.5 °C

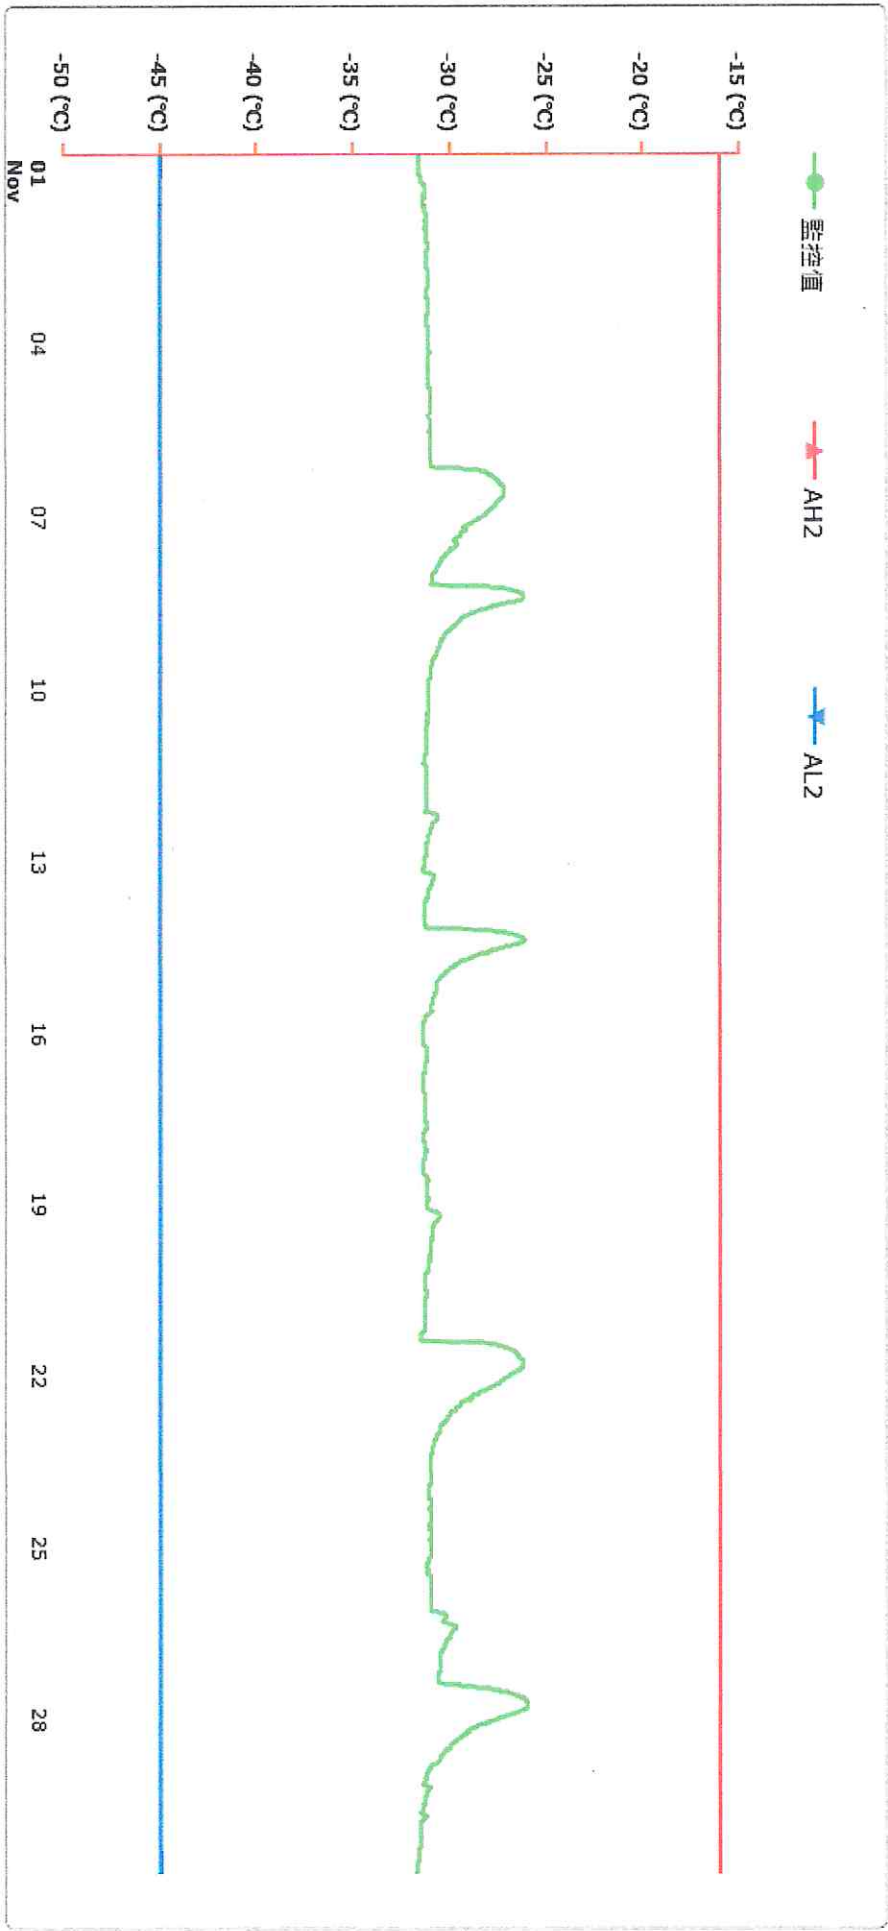

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.12.04