

監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2025-03-01 00:00 ~ 2025-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -30 °C

最小值: -37.5 °C

平均值: -35.9 °C

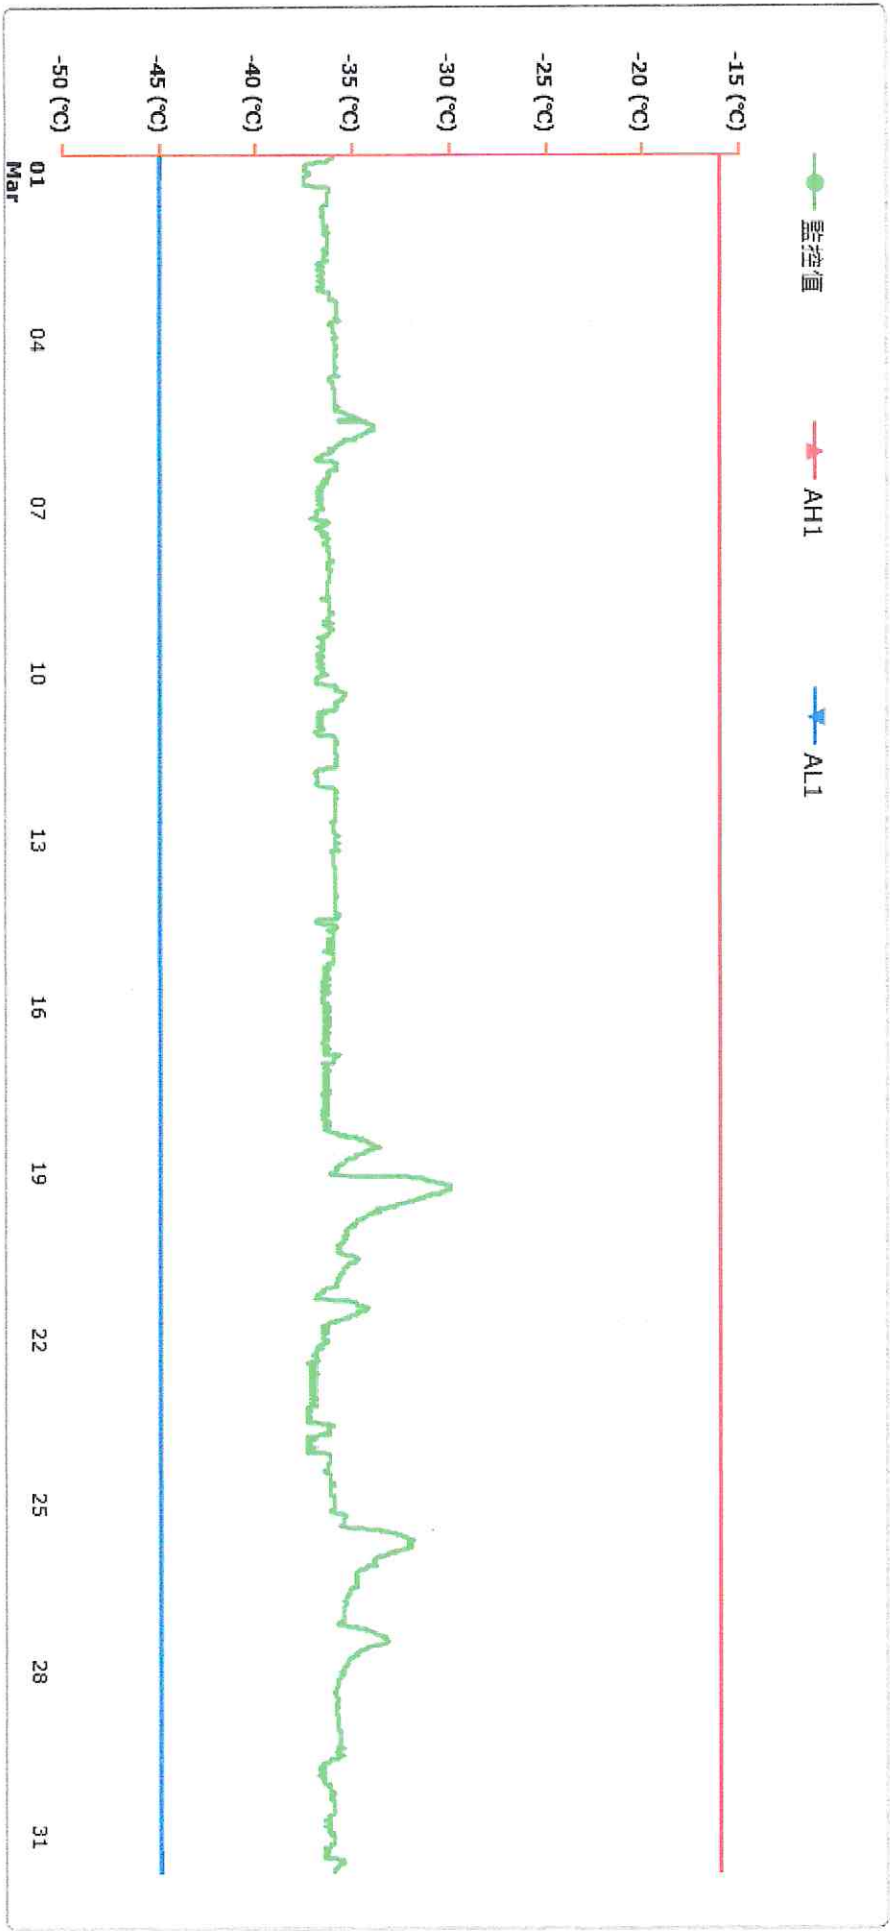

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬 2025.04.06

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(下)電

時間區間: 2025-03-01 00:00 ~ 2025-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -21.6℃

最小值: -31.5℃

平均值: -30.2℃

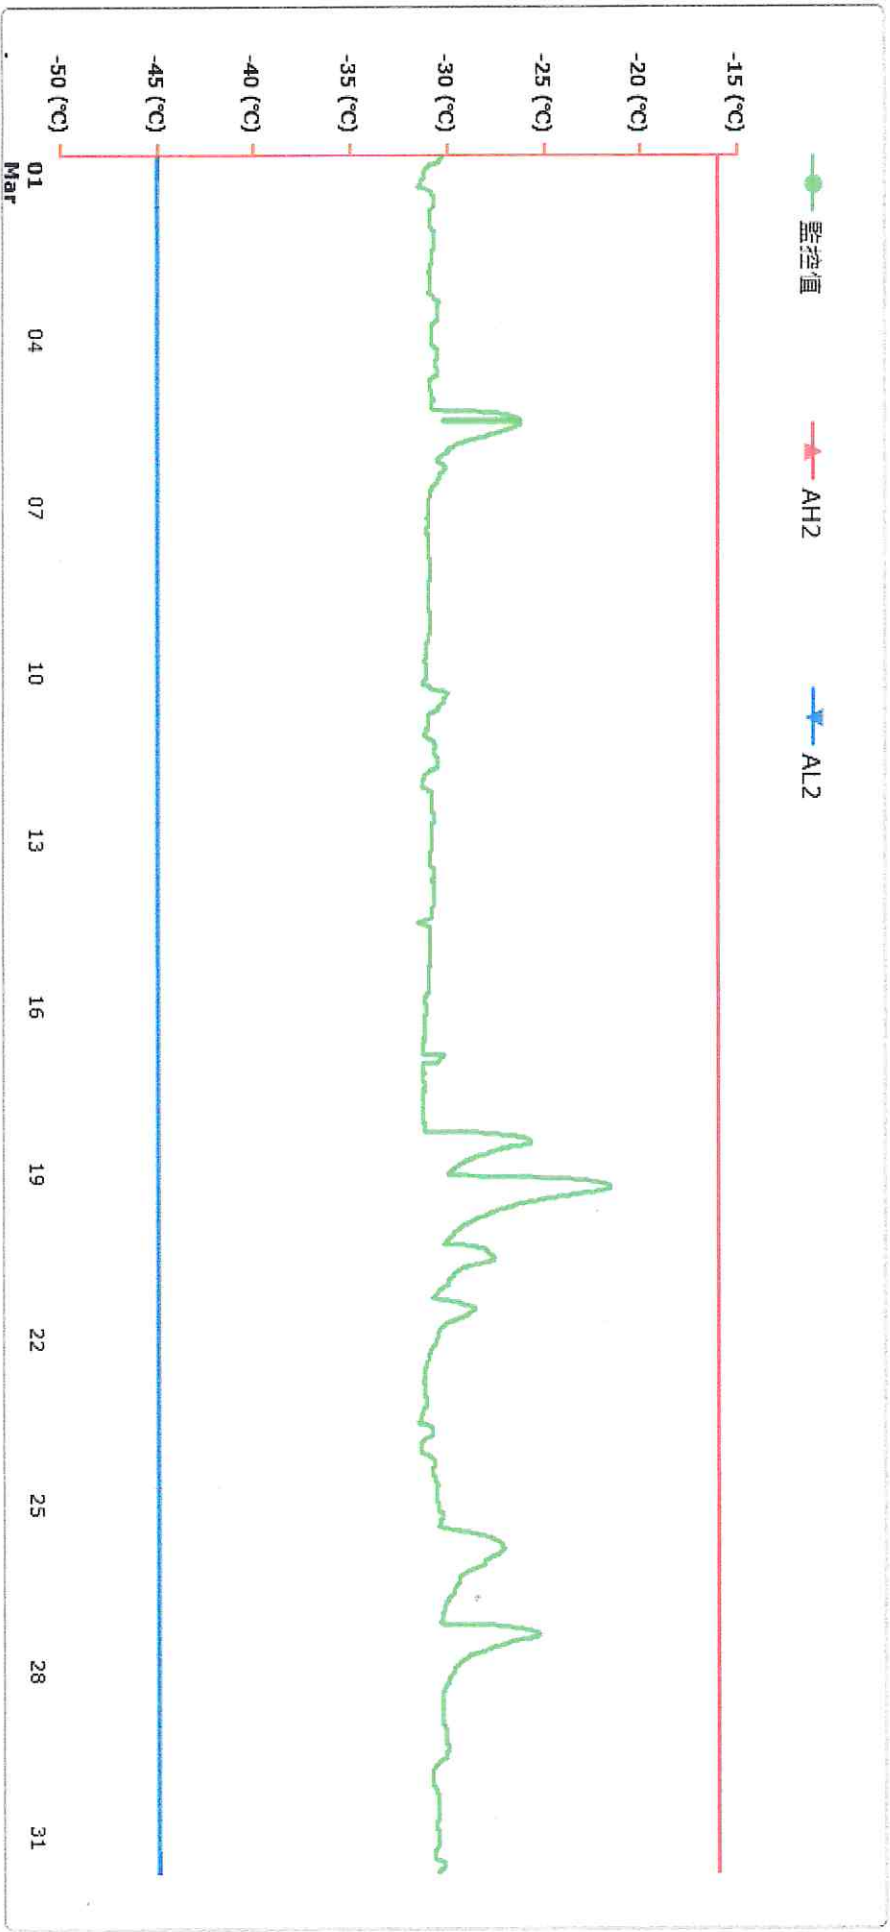

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2025.04.06