

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2026-01-01 00:00 ~ 2026-01-31 23:59

最大值: -28.3 °C

最小值: -36.6 °C

平均值: -34.2 °C

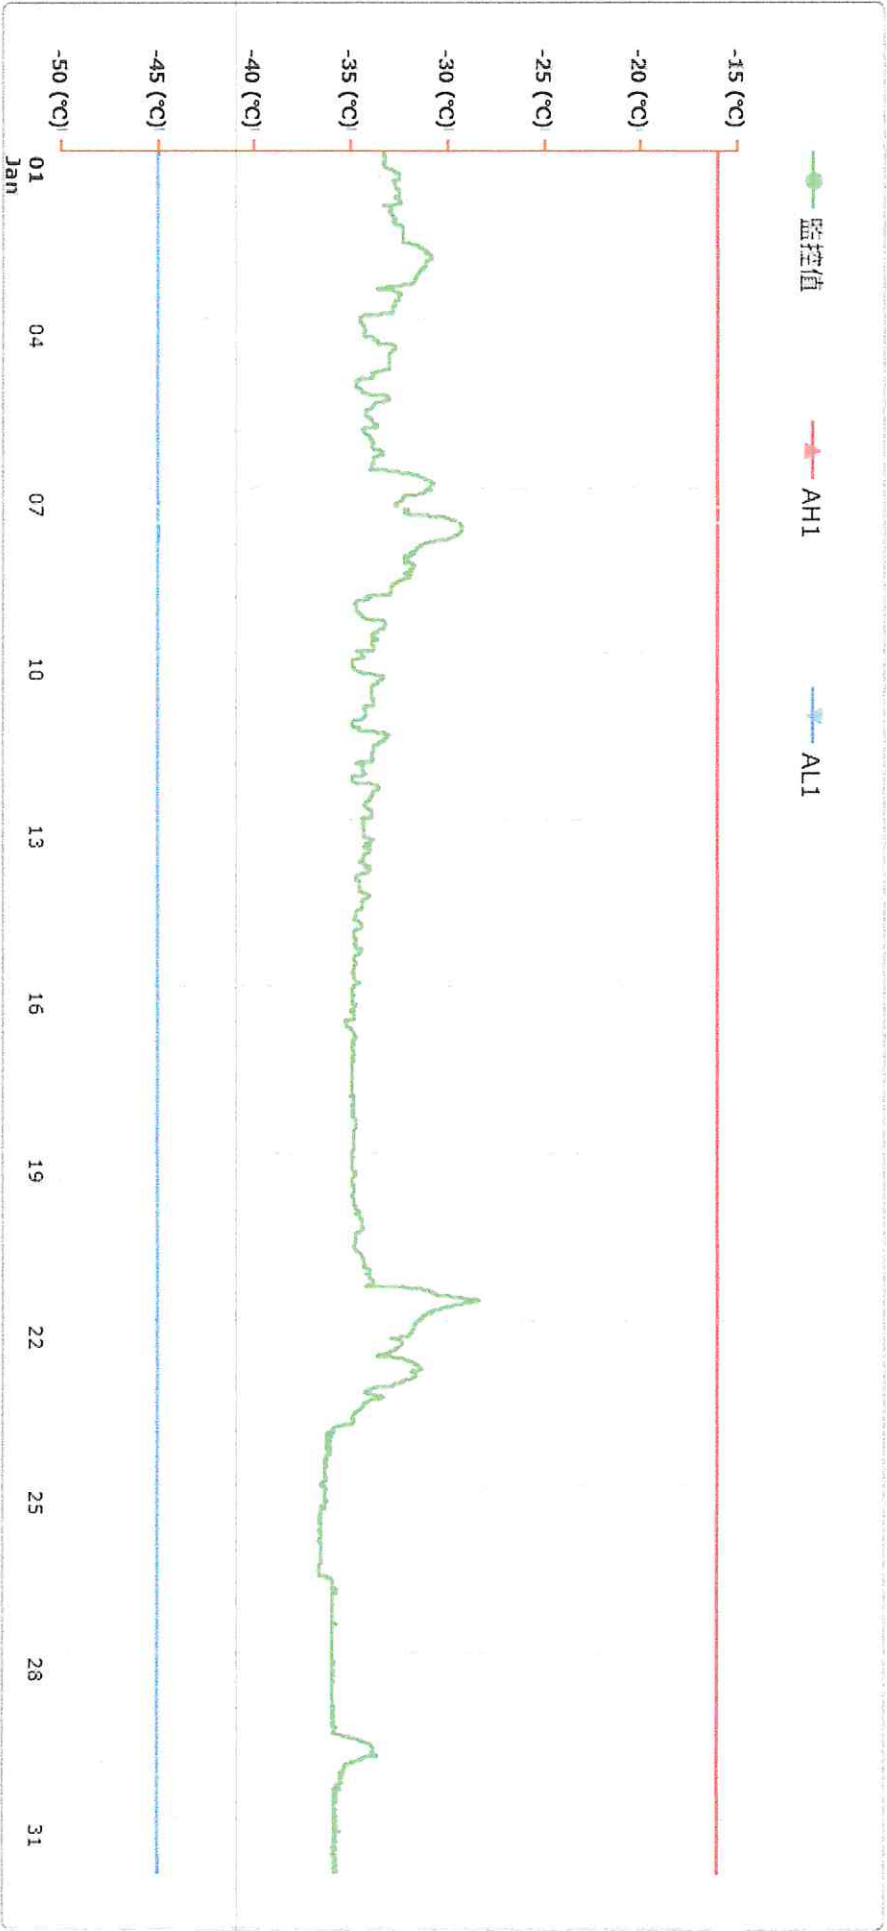

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬恩 2026.02.09

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2026-01-01 00:00 ~ 2026-01-31 23:59

最大值: -22.4 °C

最小值: -30.8 °C

平均值: -28.2 °C

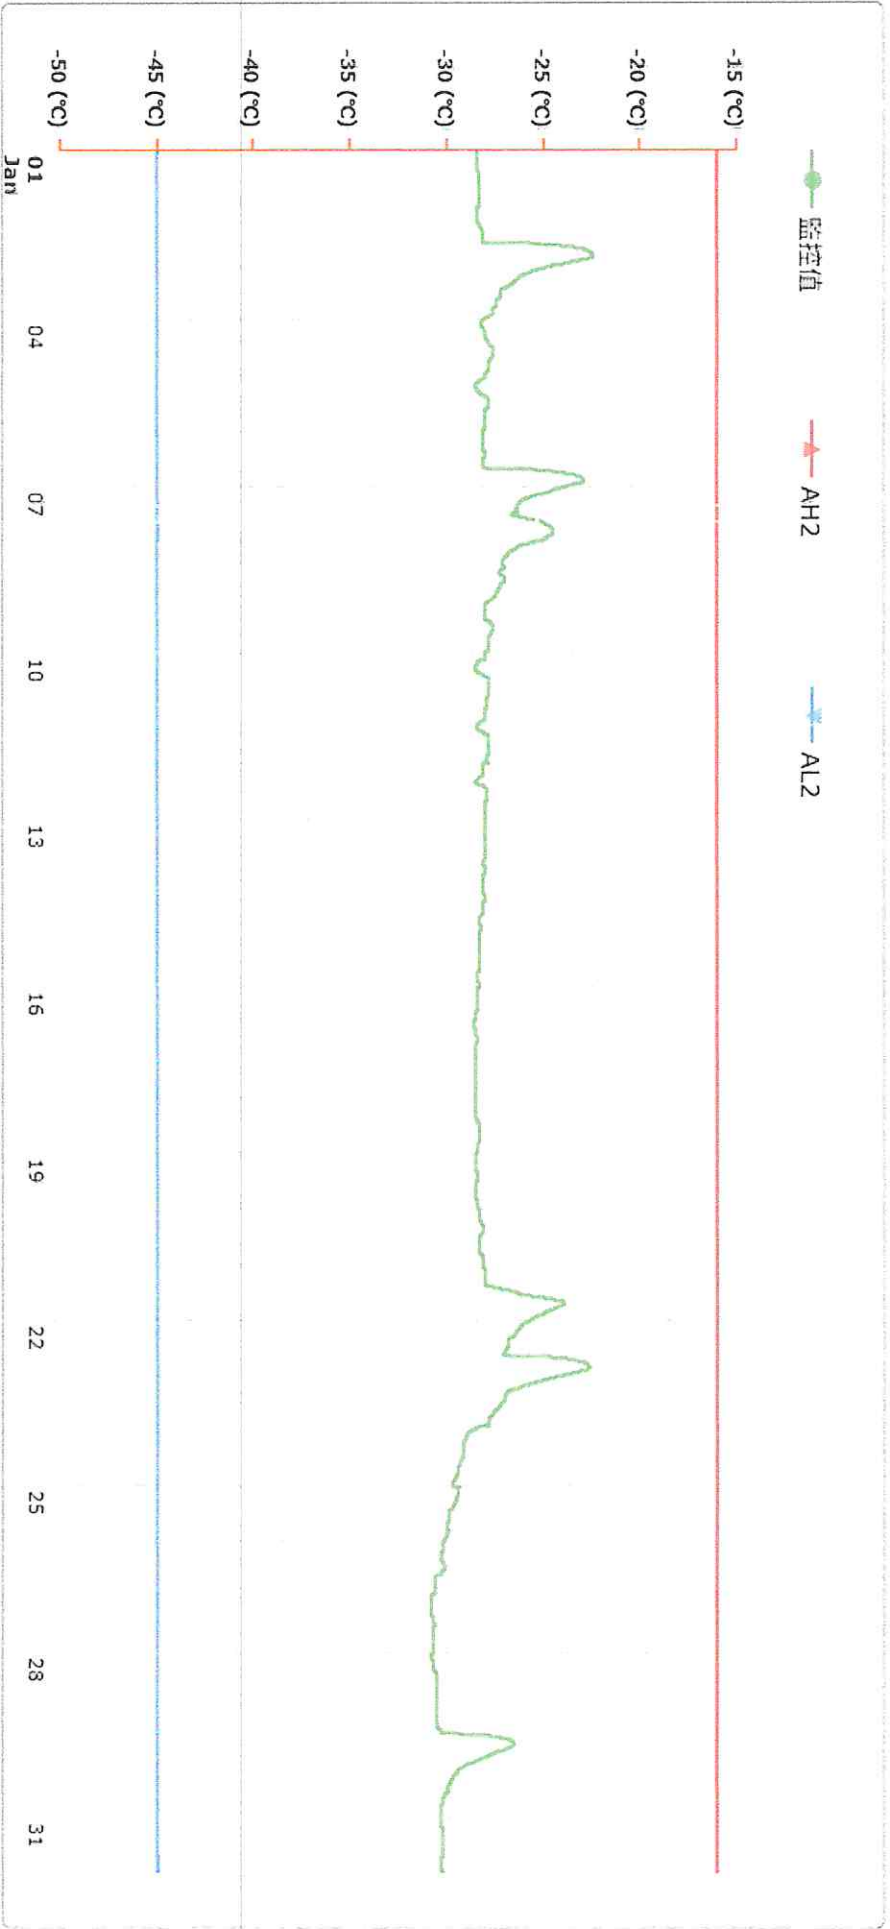

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2026.02.09