

# 監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2026-04-01 00:00 ~ 2026-04-30


話: 3933

23:59

最大值: -75.4 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -80.5 °C

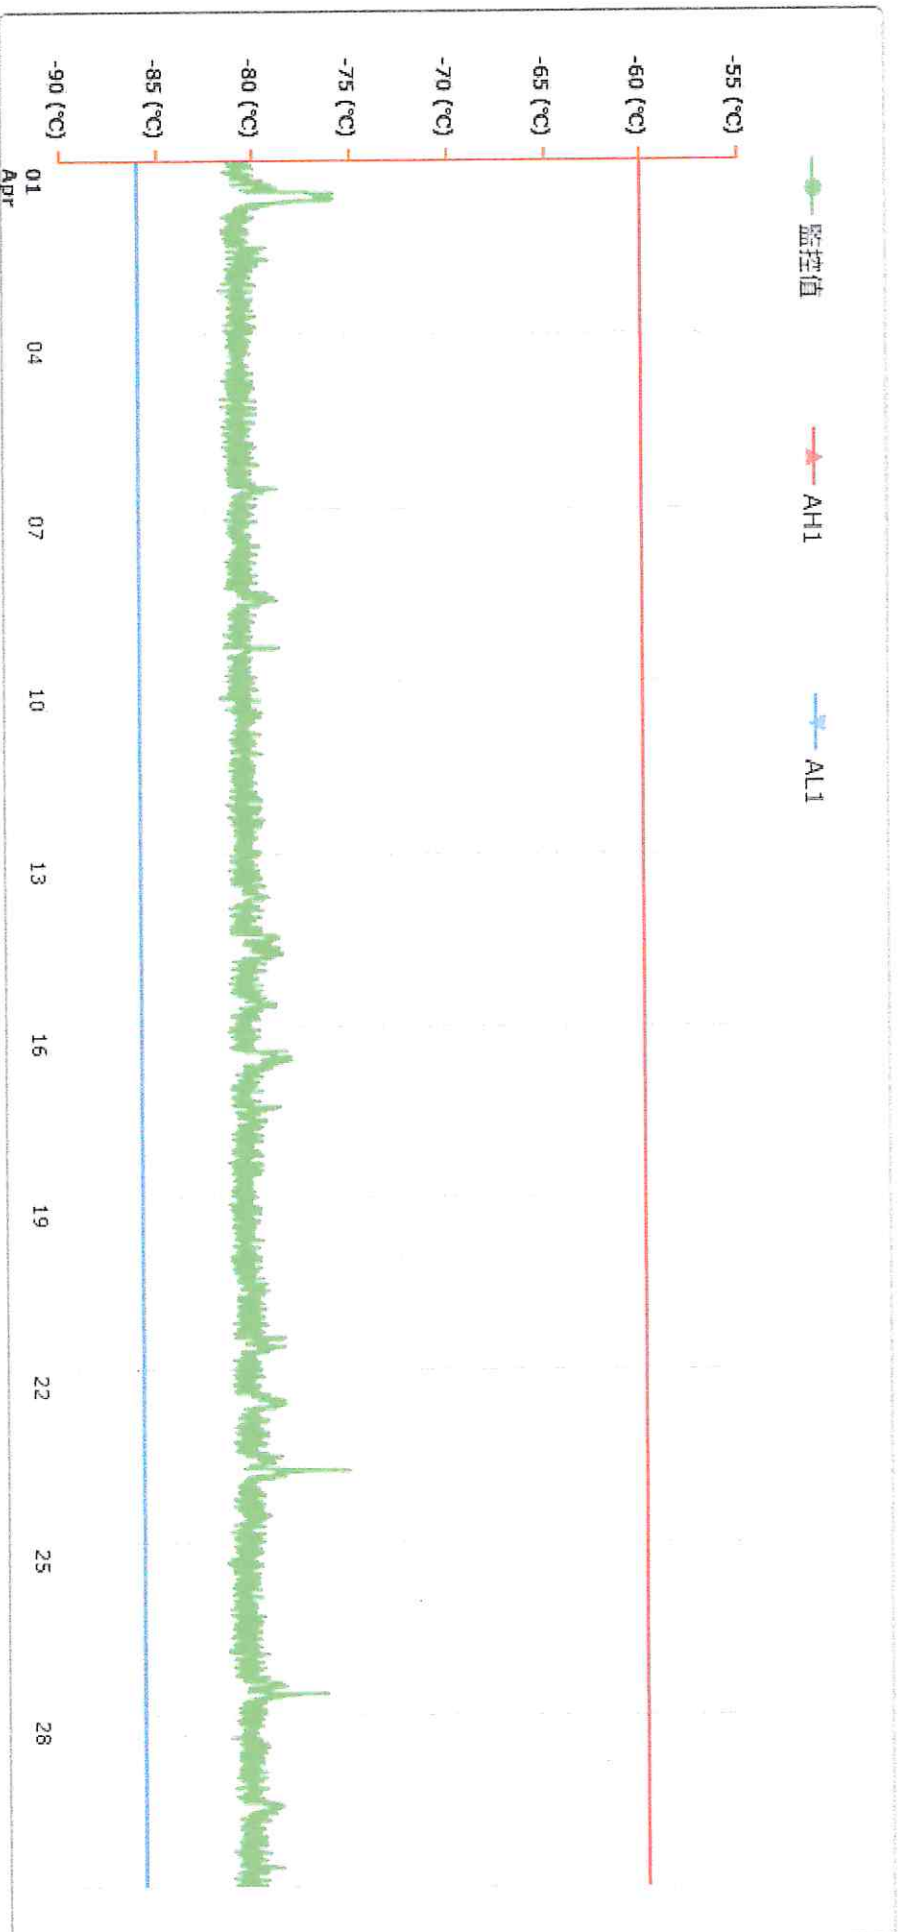

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2026.05.08

# 監控點圖表


監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電  
話: 3933

時間區間: 2026-04-01 00:00 ~ 2026-04-30  
23:59

最大值: -77.6 °C

最小值: -82.7 °C

平均值: -80.9 °C

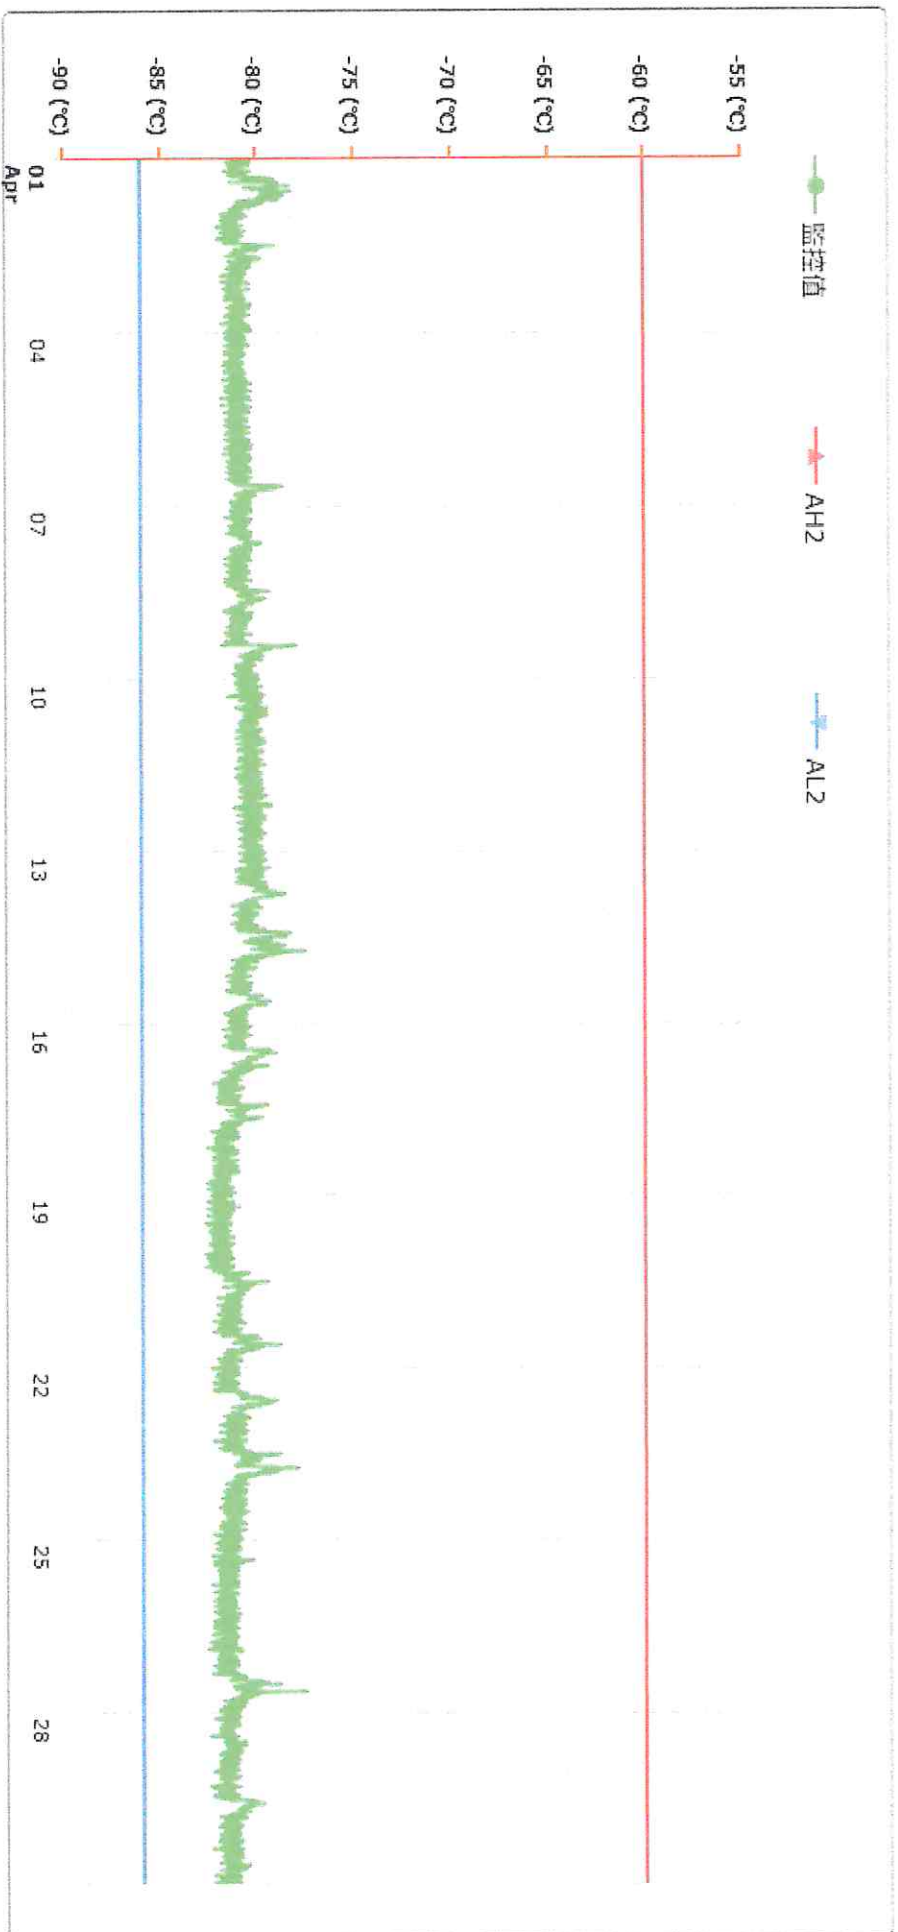

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2026.05.08