


監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2024-04-01 00:00 ~ 2024-04-30 23:59

最大值: -75.4 °C      最小值: -83.6 °C      平均值: -81.5 °C

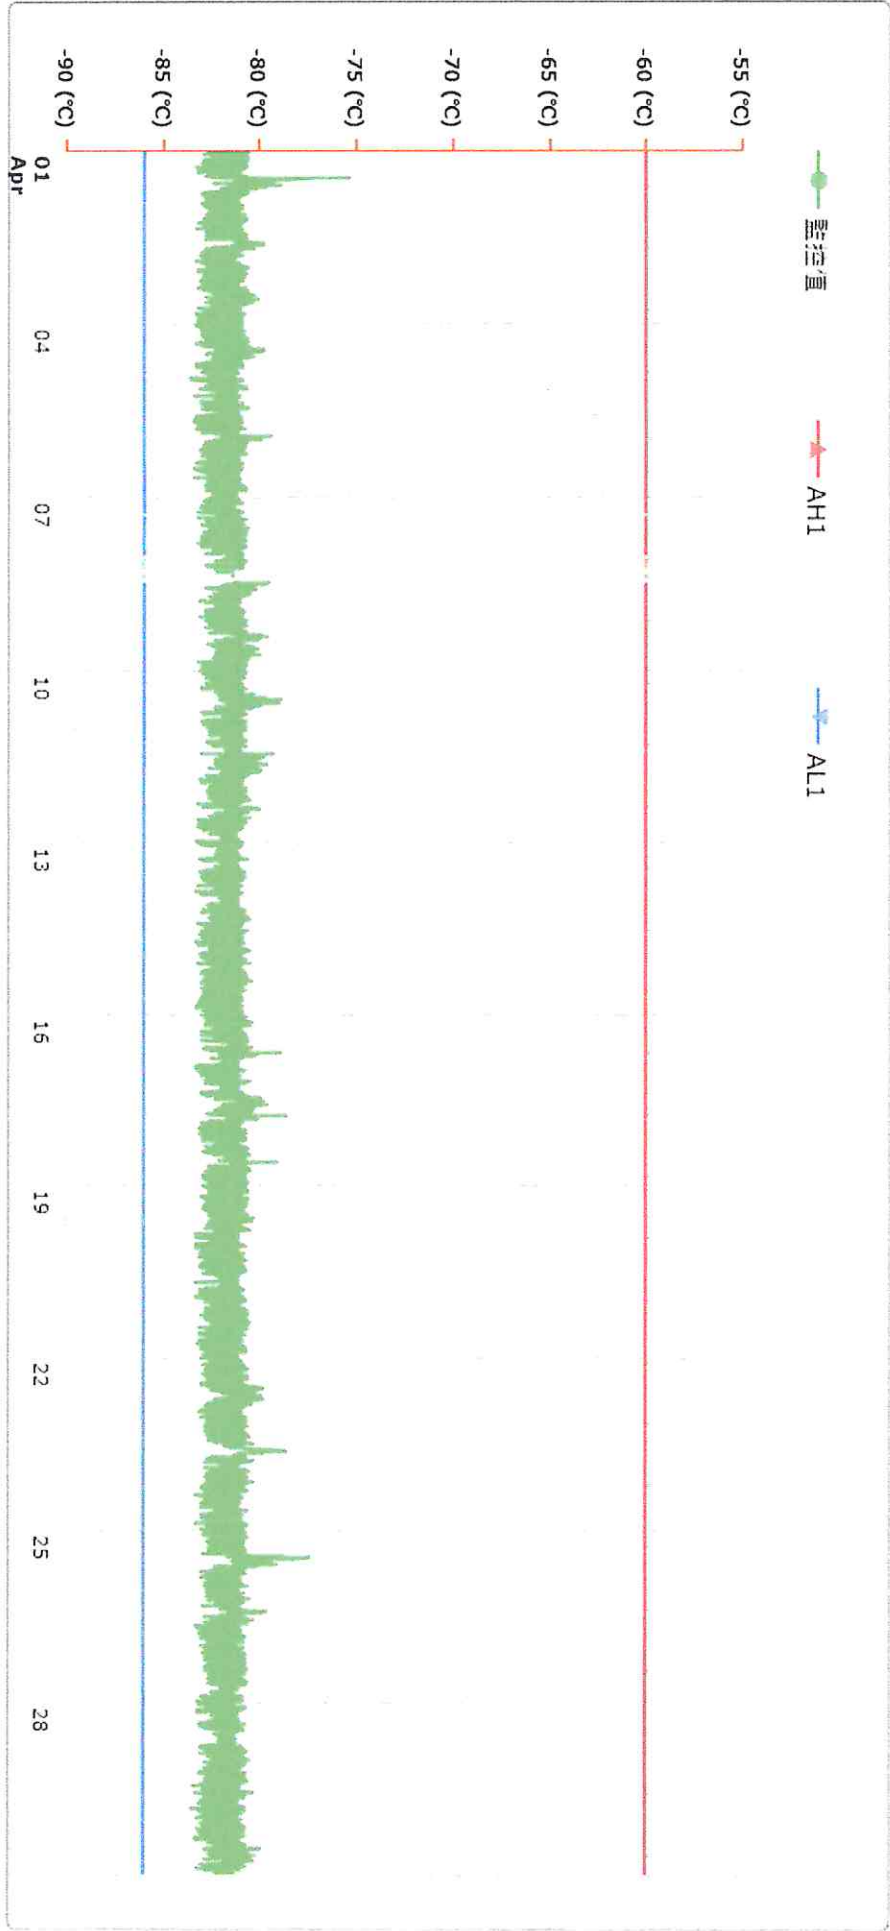

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.05.08

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電

時間區間: 2024-04-01 00:00 ~ 2024-04-30


話: 3933

23:59

最大值: -72.8 °C

最小值: -82.6 °C

平均值: -80.4 °C

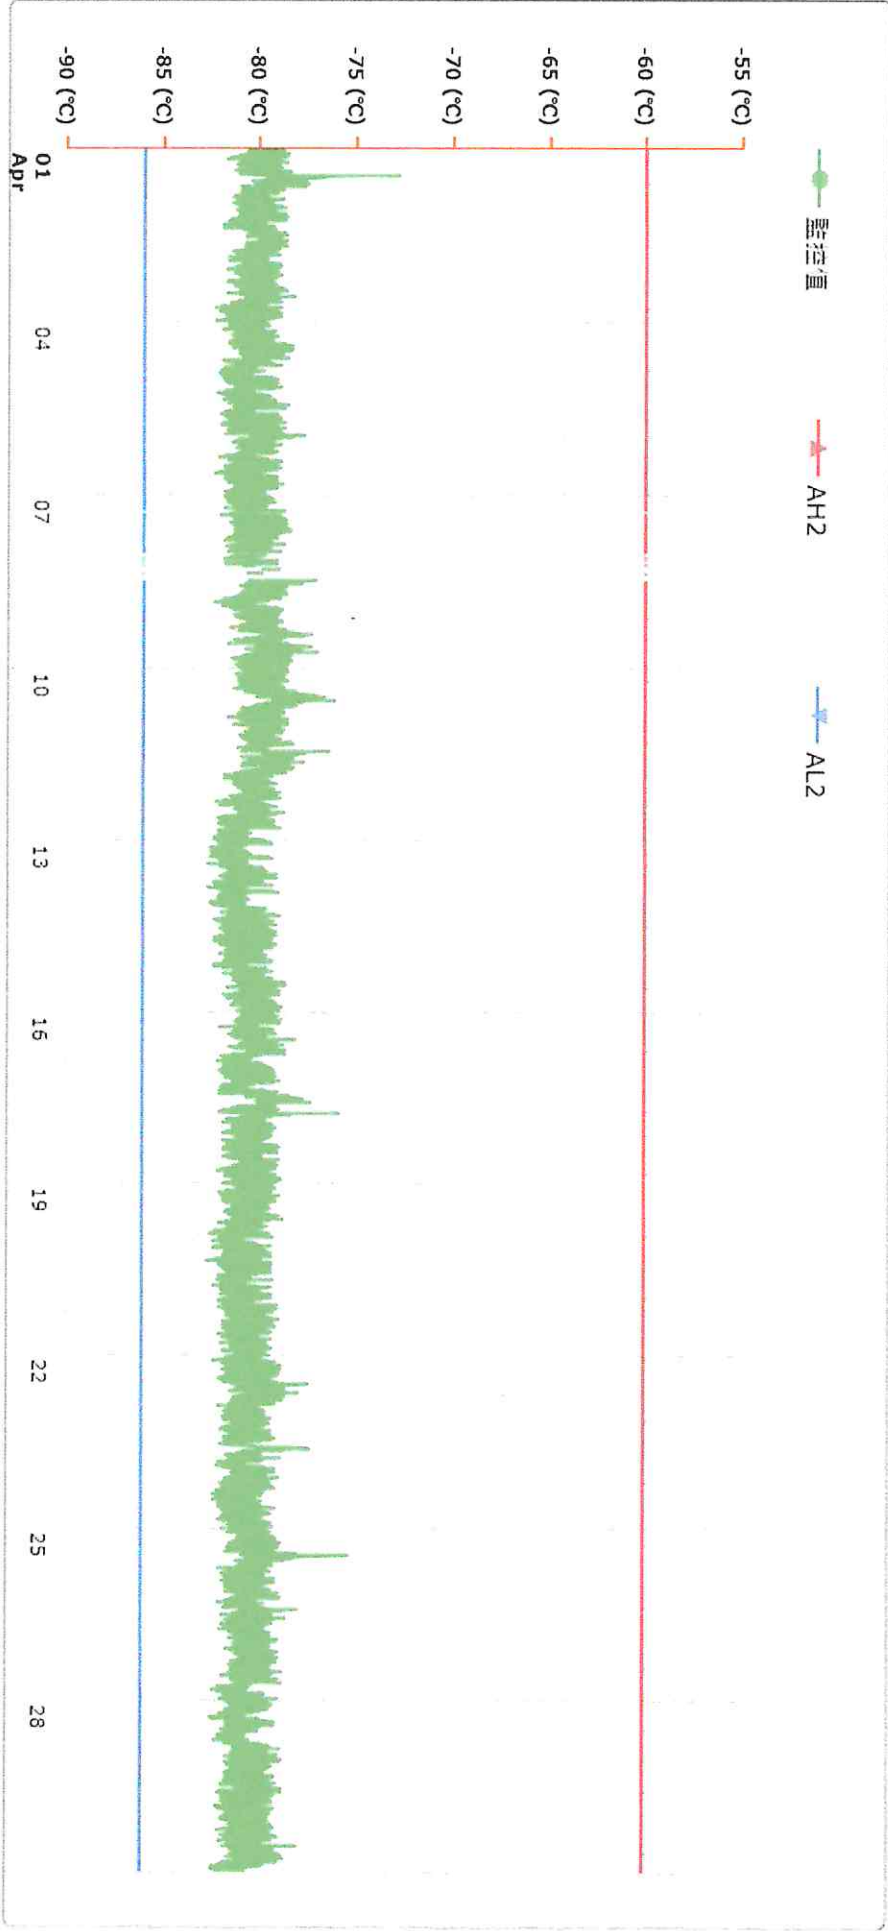

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.05.08