

監控點圖表


監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2024-06-01 00:00 ~ 2024-06-30 23:59

最大值: -75.2 °C

最小值: -83.6 °C

平均值: -81.4 °C

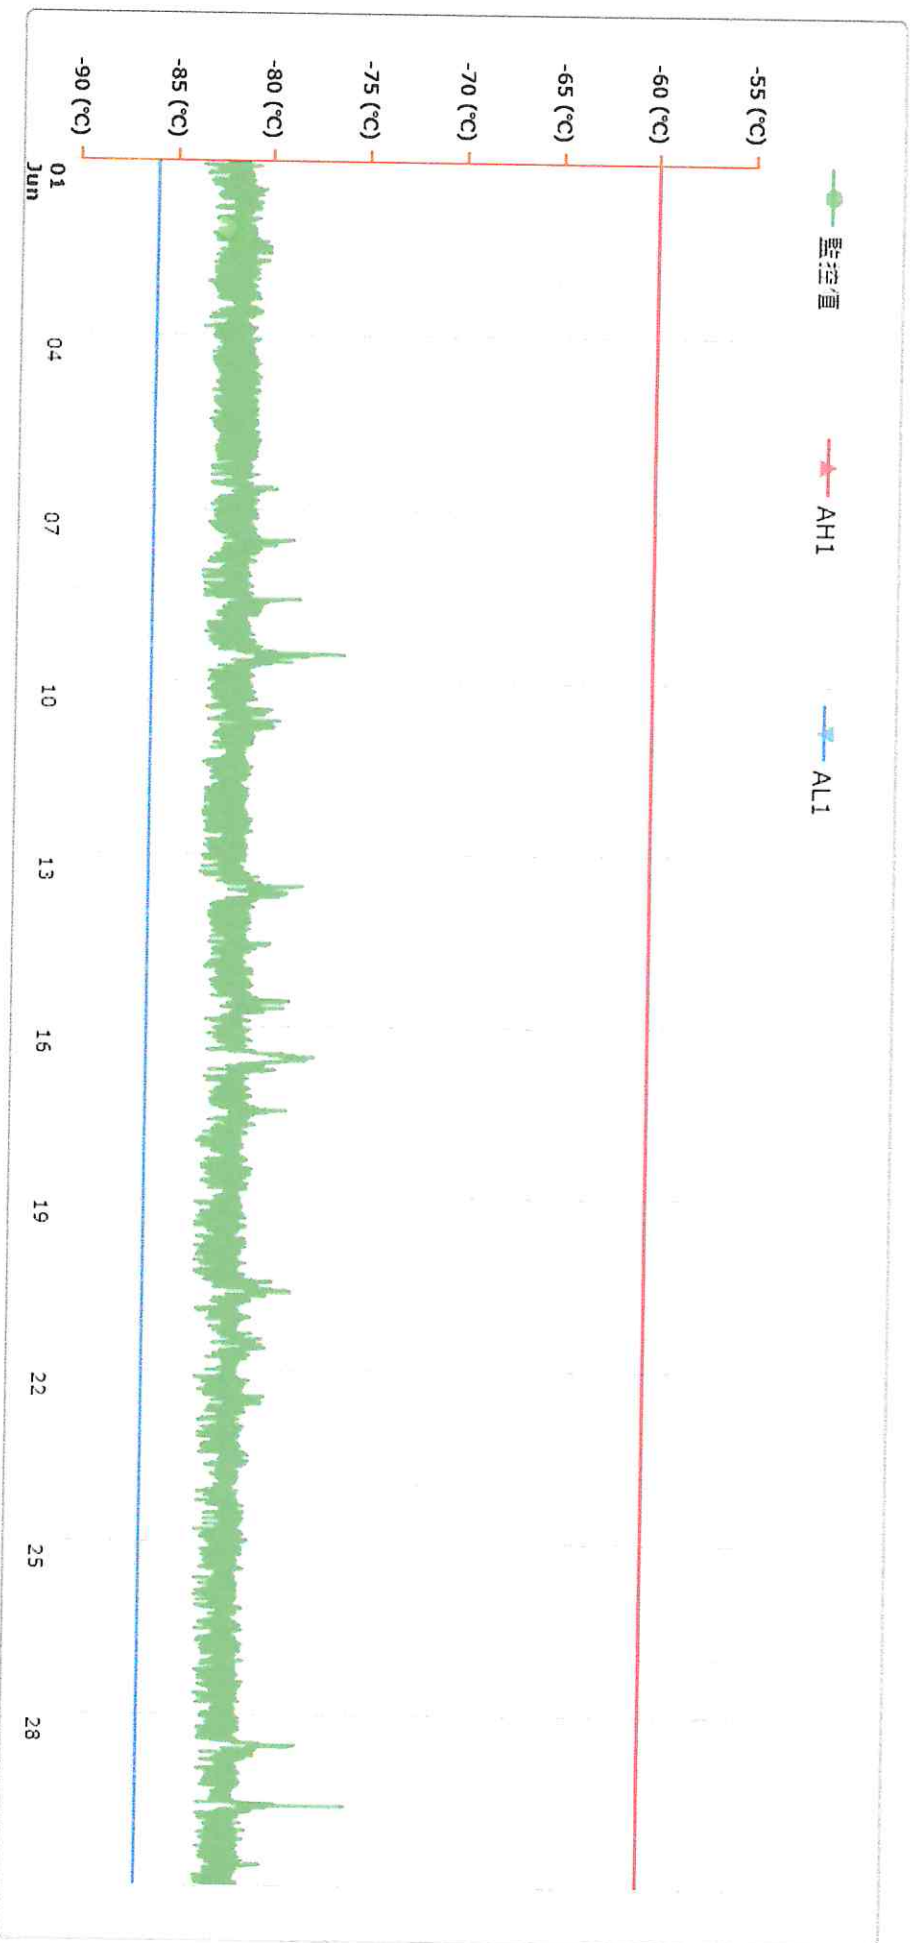

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬 2024.07.09

監控點圖表


監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2024-06-01 00:00 ~ 2024-06-30 23:59

最大值: -75 °C

最小值: -82.7 °C

平均值: -80.5 °C

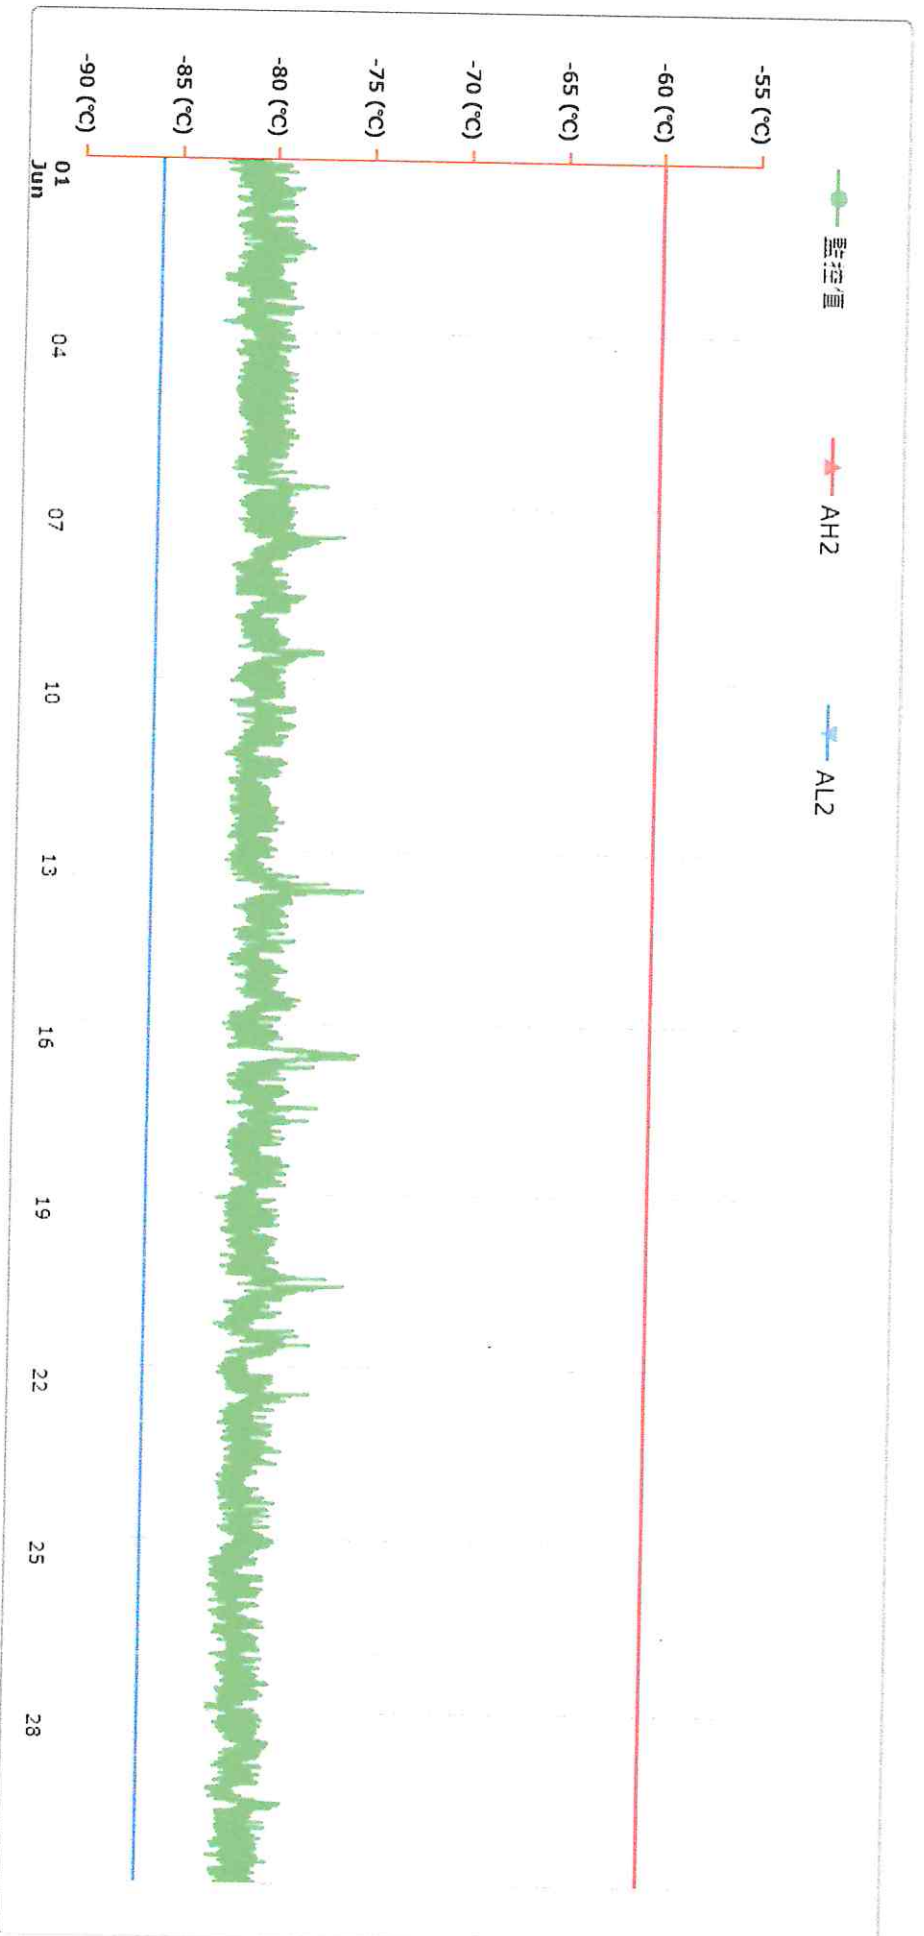

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.07.09