

監控點圖表


監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2024-11-01 00:00 ~ 2024-11-30 23:59

最大值: -77.8 °C

最小值: -82.9 °C

平均值: -81.1 °C

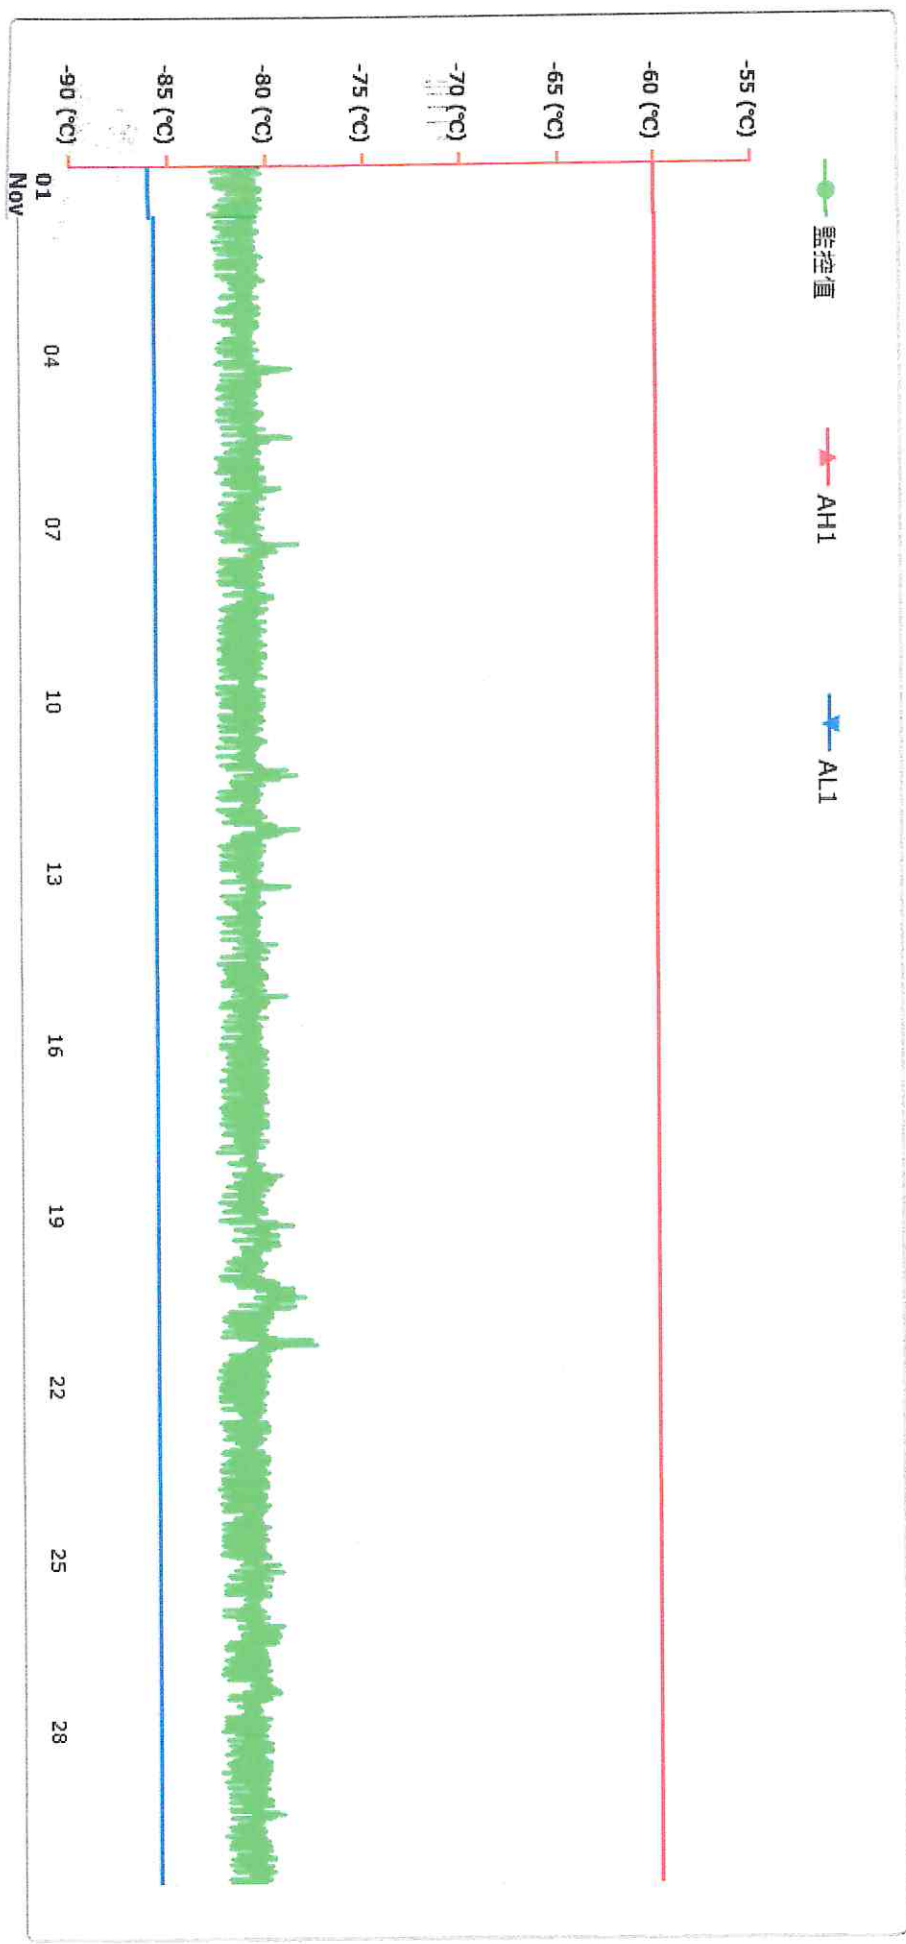

臨床試驗中心-公用


單位主管: 許淑英 2024.12.04

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2024-11-01 00:00 ~ 2024-11-30 23:59

最大值: -75.2 °C 最小值: -82.3 °C 平均值: -80.6 °C

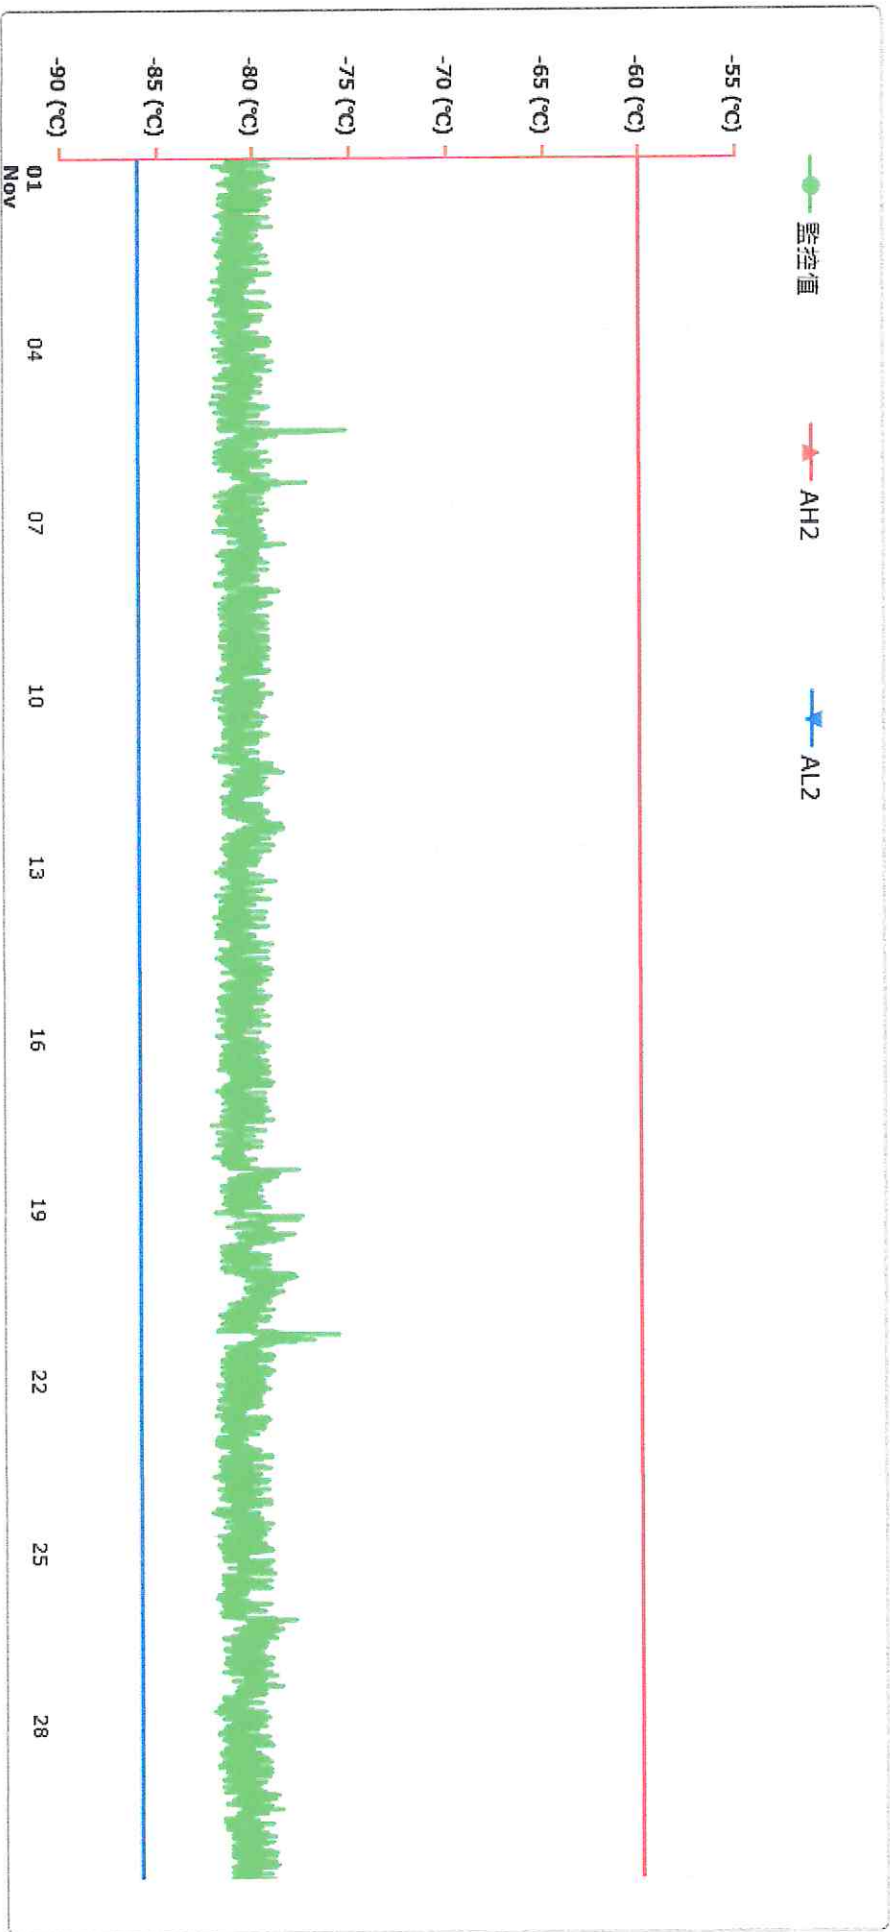

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑英 2024.12.04