

# 監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -72.7 °C

最小值: -82.2 °C

平均值: -80.6 °C

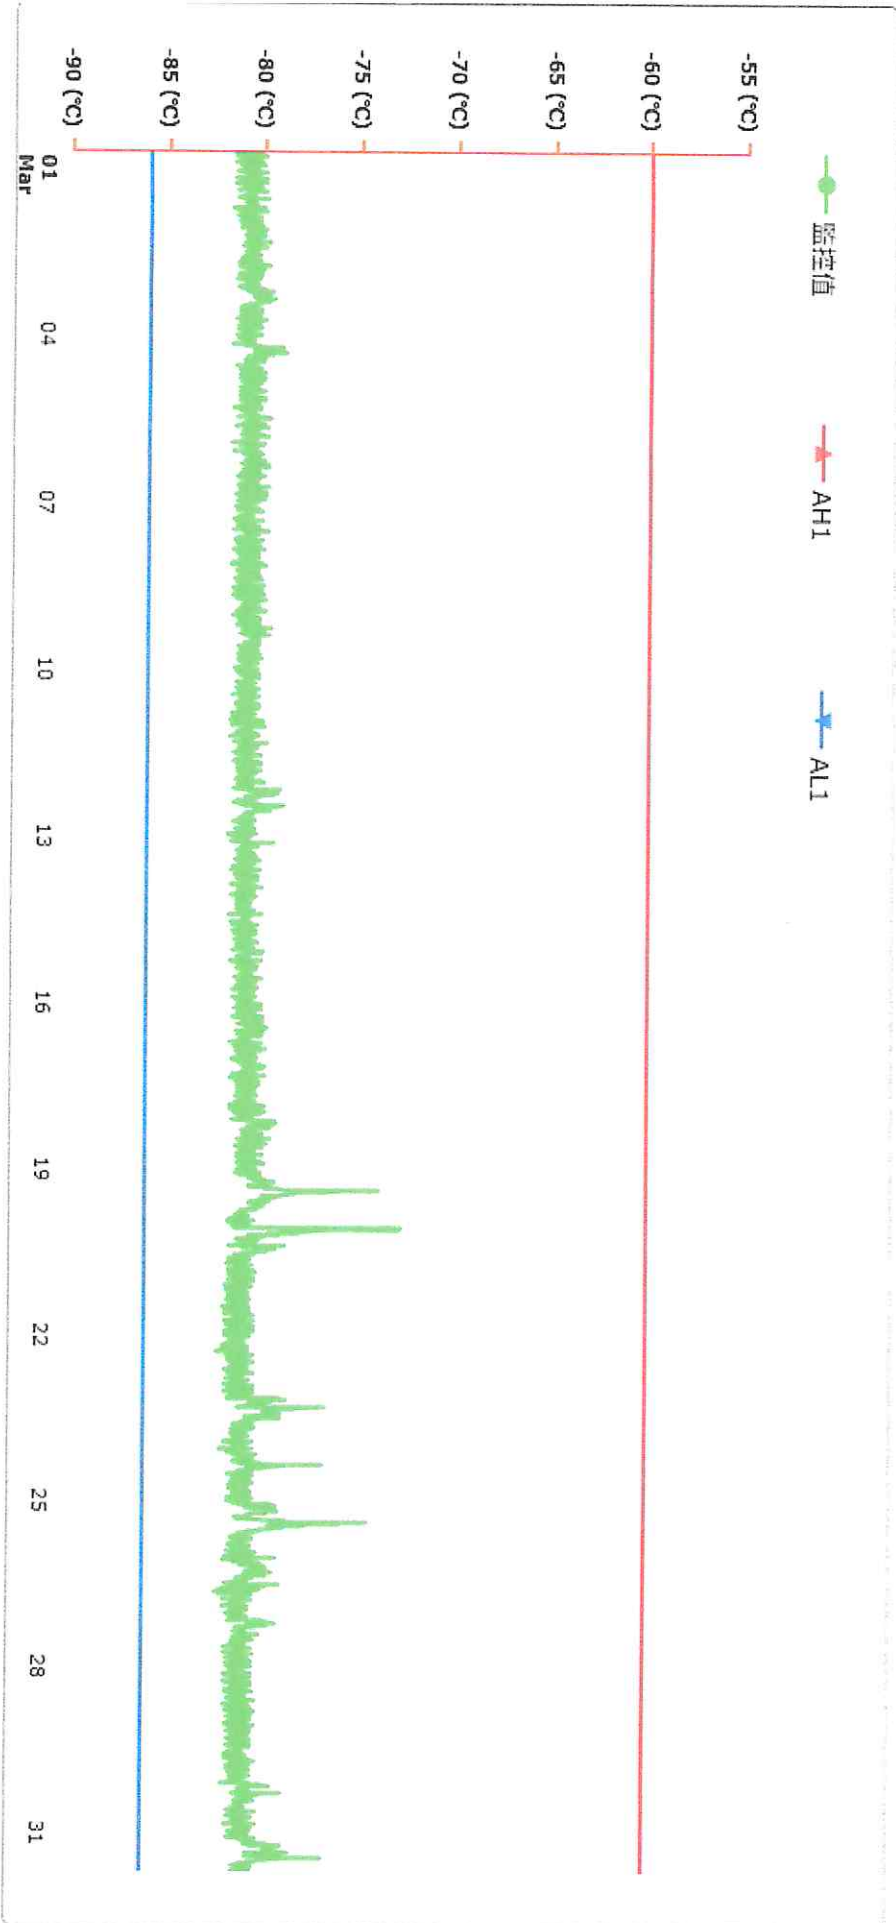

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑曼 2026.04.02

# 監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -72.9 °C

最小值: -82.6 °C

平均值: -80.7 °C

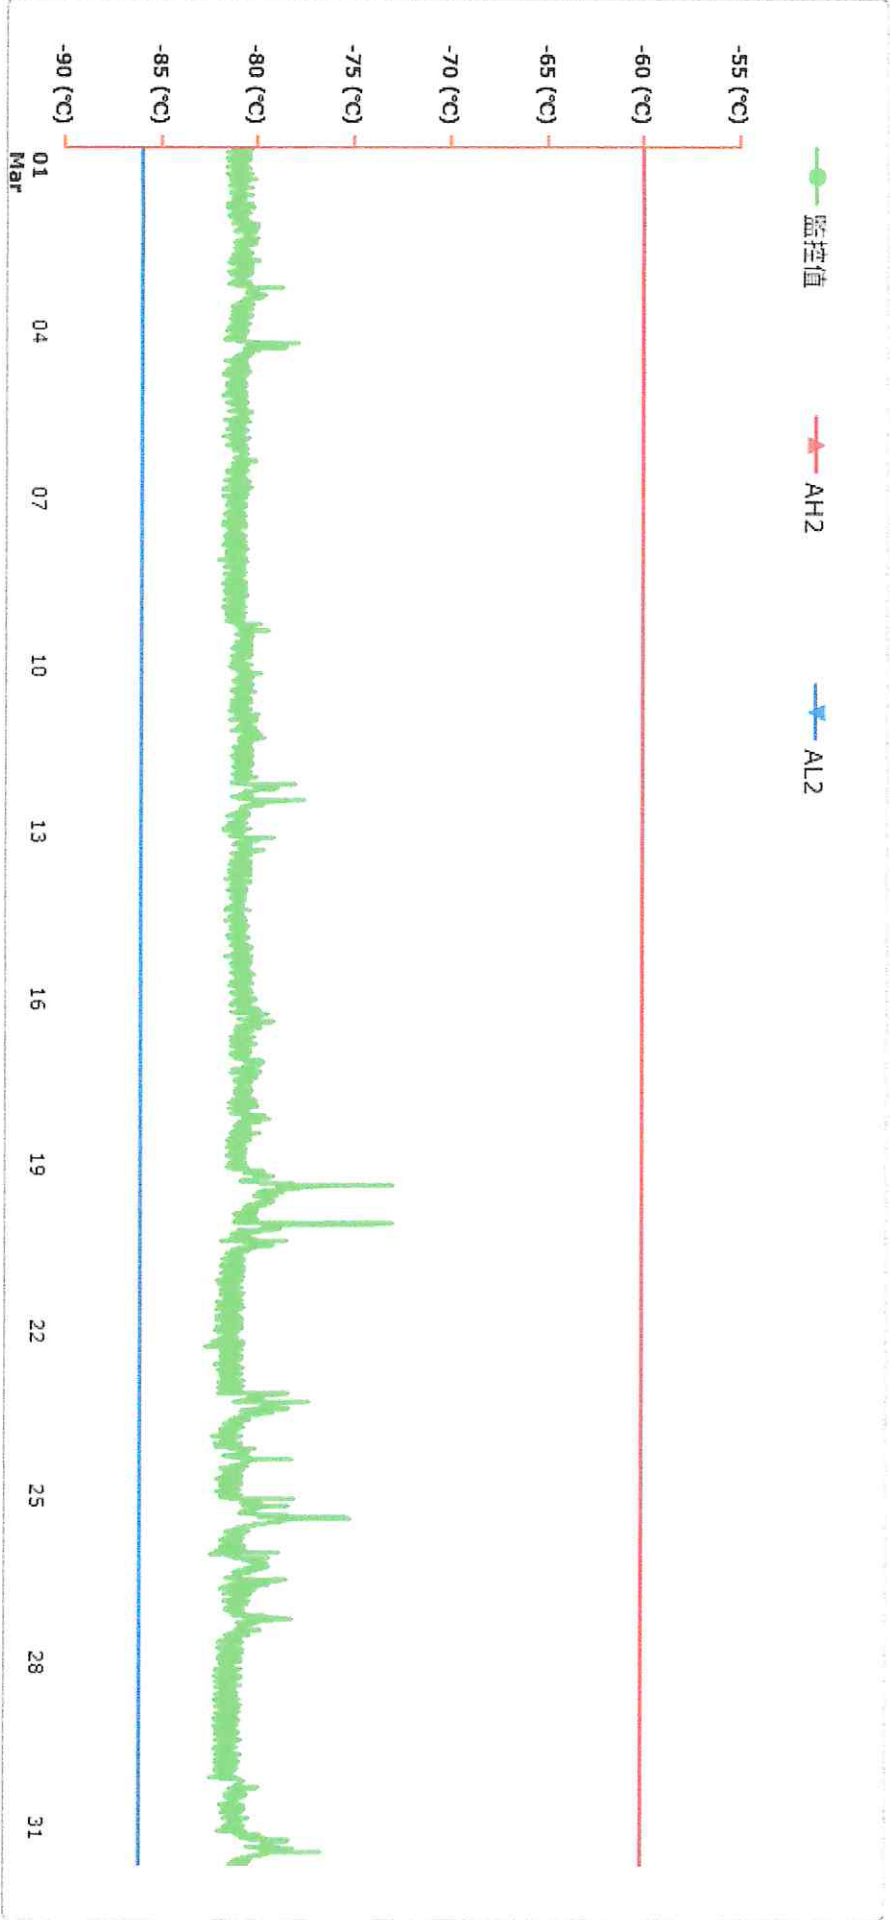

製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2026.04.02